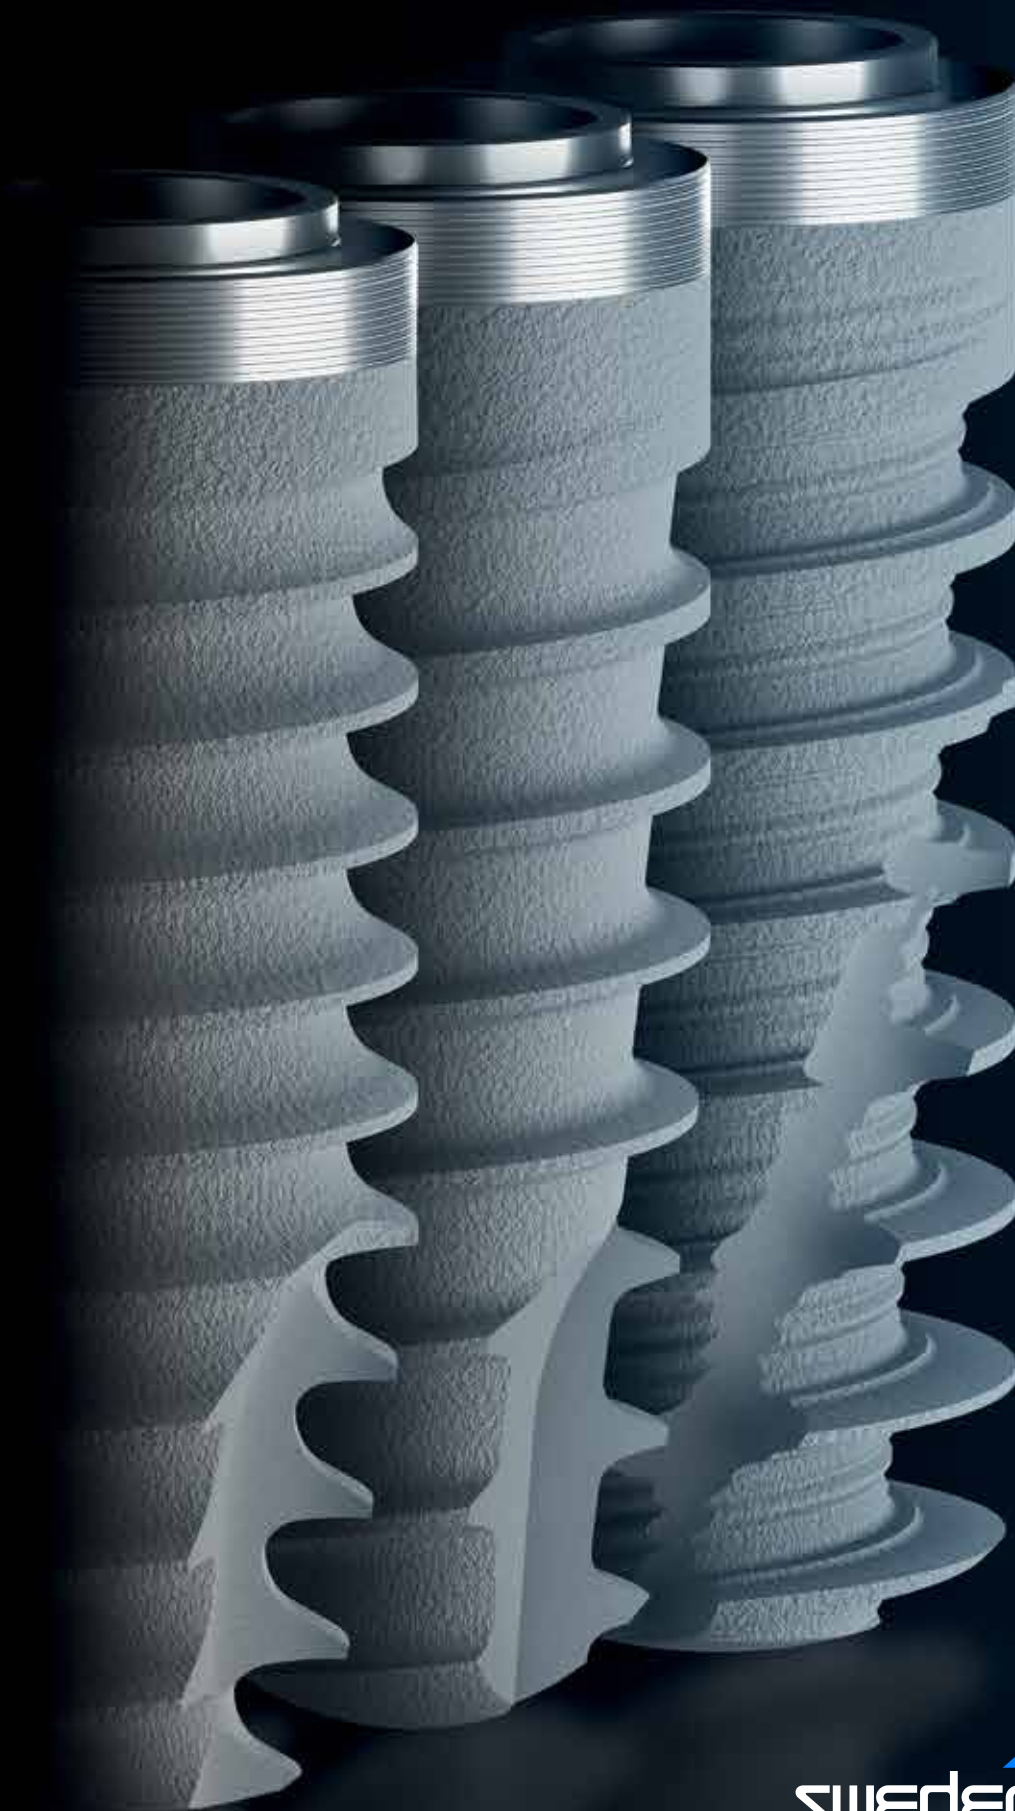


PREMIUM - SHELTA **POWER**

Catalogul





Sweden & Martina
















Dental Arena

PREMIUM POWER ȘI SHELTA POWER

Index

4	Tabel implanturi Premium Power și Shelta Power
6	Premium Power Slim și Premium Power
8	Shelta Power și Shelta SL Power
10	UTM și ZirTi: două suprafețe în sinergie
12	Avantajele conexiunii unice Collex
14	Flux digital de lucru cu Premium Power și Shelta Power
16	Ergonomia procedurilor chirurgicale
18	Kituri chirurgicale
24	Kituri chirurgicale pentru chirurgia ghidată
28	Componente pentru chirurgia ghidată
28	Instrumente chirurgicale opționale
31	Marcaje de adâncime
32	Soluții protetice de excelență
34	Platforme implantare și combinații protetice
35	Transmucoase de vindecare
36	Tehnica REGISTRA
37	Fază de amprentare și model
38	Piloni provizorii
39	Piloni preformați
40	Piloni și componente pentru tehnica verticală
41	Piloni frezabili
42	Linia protetică XA
44	Piloni calcinabili
45	Soluții cu orificiu pentru șurub înclinat
46	Linia protetică PAD [®] (Proteze Înșurubate Disparalele Estetice)
48	Linia protetică PLAIN B-Space
49	Proteze conometrice Conico
50	Componente pentru proteze digitale
55	Componente pentru proteze digitale chairside
56	Soluții pentru overdenture
59	Șuruburi protetice clinice și de laborator
60	Secvențe de pregătire a sitului implantar

Implanturi Premium Power și Shelta Power



















	Premium Slim*	Premium Power		
corp h	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
7.00 mm	-	 A-ZT-P380-070	 A-ZT-P425-070	 A-ZT-P500-070
8.50 mm	 A-ZT-P330-085	 A-ZT-P380-085	 A-ZT-P425-085	 A-ZT-P500-085
10.00 mm	 A-ZT-P330-100	 A-ZT-P380-100	 A-ZT-P425-100	 A-ZT-P500-100
11.50 mm	 A-ZT-P330-115	 A-ZT-P380-115	 A-ZT-P425-115	 A-ZT-P500-115
13.00 mm	 A-ZT-P330-130	 A-ZT-P380-130	 A-ZT-P425-130	 A-ZT-P500-130
15.00 mm	 A-ZT-P330-150	 A-ZT-P380-150	 A-ZT-P425-150	 A-ZT-P500-150
18.00 mm	-	 A-ZT-P380-180	 A-ZT-P425-180	-
șuruburi capac	 A-VT-330	 A-VT-380	 SH-VT-425-BL	 SH-VT-500-VI

* Implanturile dentare Sweden & Martina sunt dispozitive implantabile indicate pentru reabilitarea pacienților afectați de edentație totală sau parțială. Sunt destinate inserării chirurgicale în osul mandibular sau maxilar. Sistemele implantare Sweden & Martina sunt destinate procedurilor chirurgicale atât într-o singură etapă, cât și în două etape.

Datorită diametrului lor, implanturile cu diametru egal sau mai mic de 3,30 mm sunt recomandate în cazurile în care grosimea osoasă este redusă. Pot fi utilizate pentru reabilitarea coroanelor unice pentru dinții intermediari și canini.


Datorită dimensiunilor reduse, nu sunt potrivite pentru reabilitarea coroanelor unice în poziție premolară sau molară.

În sectoarele distale, aceste implanturi pot fi utilizate doar în reabilitări cu bare sau punți, în combinație cu implanturi de dimensiuni mai mari.

	Shelta Power			Shelta Power SL		
	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
	-	-	-	-	-	-
	 SH-ZT-PS380-085	 SH-ZT-PS425-085	 SH-ZT-PS500-085	 SH-ZT-PS380SL-085	 SH-ZT-PS425SL-085	 SH-ZT-PS500SL-085
	 SH-ZT-PS380-100	 SH-ZT-PS425-100	 SH-ZT-PS500-100	 SH-ZT-PS380SL-100	 SH-ZT-PS425SL-100	 SH-ZT-PS500SL-100
	 SH-ZT-PS380-115	 SH-ZT-PS425-115	 SH-ZT-PS500-115	 SH-ZT-PS380SL-115	 SH-ZT-PS425SL-115	 SH-ZT-PS500SL-115
	 SH-ZT-PS380-130	 SH-ZT-PS425-130	 SH-ZT-PS500-130	 SH-ZT-PS380SL-130	 SH-ZT-PS425SL-130	 SH-ZT-PS500SL-130
	 SH-ZT-PS380-150	 SH-ZT-PS425-150	 SH-ZT-PS500-150	 SH-ZT-PS380SL-150	 SH-ZT-PS425SL-150	 SH-ZT-PS500SL-150
	-	-	-	-	-	-
	 SH-VT-380-VE	 SH-VT-425-BL	 SH-VT-500-VI	 SH-VT-380-VE	 SH-VT-425-BL	 SH-VT-500-VI

Premium Power

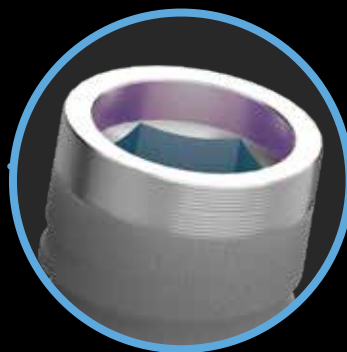SLIM $\varnothing$ 3.30




CONEXIUNE COLLEX ONE

Pentru o abordare
protetică simplificată


PREMIUM SLIM POWER: MORFOLOGIE CORONARĂ

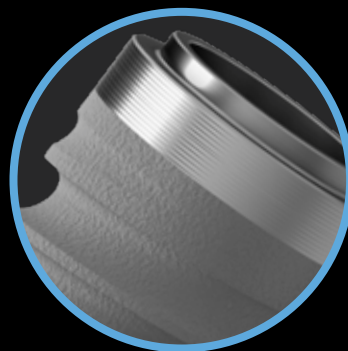Mai stabil în corticalele subțiri




MORFOLOGIE SLIM

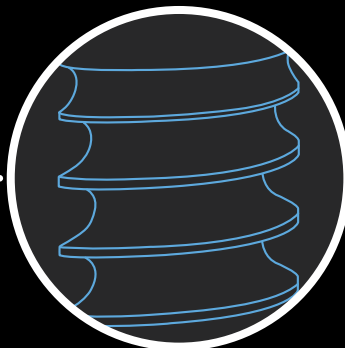Corp performant în toate
tipurile de os, pentru a nu
pierde aderența în spațiile
restrânse




INSERARE SIMPLĂ

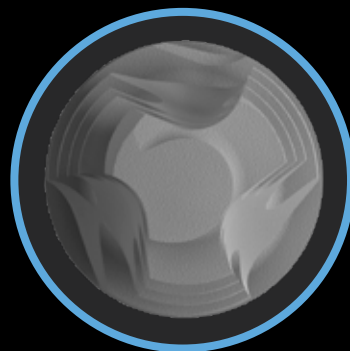Datorită studiului asupra
raportului core/spiră




Premium Power

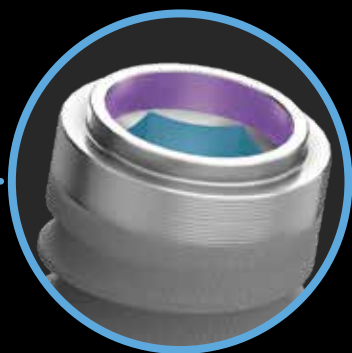Ø 3.80, Ø 4.25, Ø 5.00




GÂT UTM

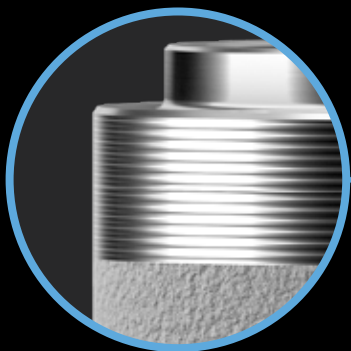Suprafața concepută pentru zona de interfață dintre țesuturile moi și țesuturile dure




PREMIUM POWER: MORFOLOGIE CORONARĂ

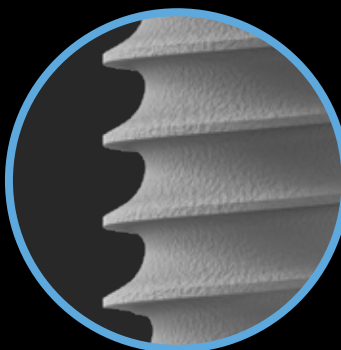Performant chiar și în corticală dură




SPIRĂ REVERSE BUTTRESS

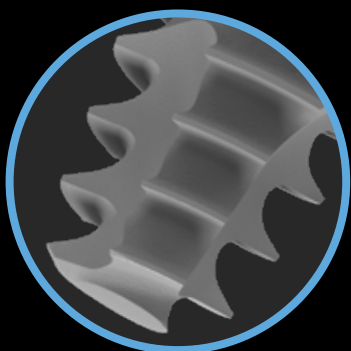Ascutit și penetrant chiar și în os dur




FREZE APICALE

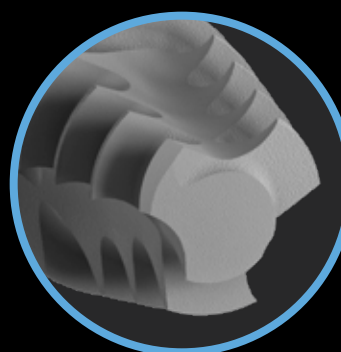Proiectate pentru a facilita inserarea și pentru decompresia cheagului




APEX

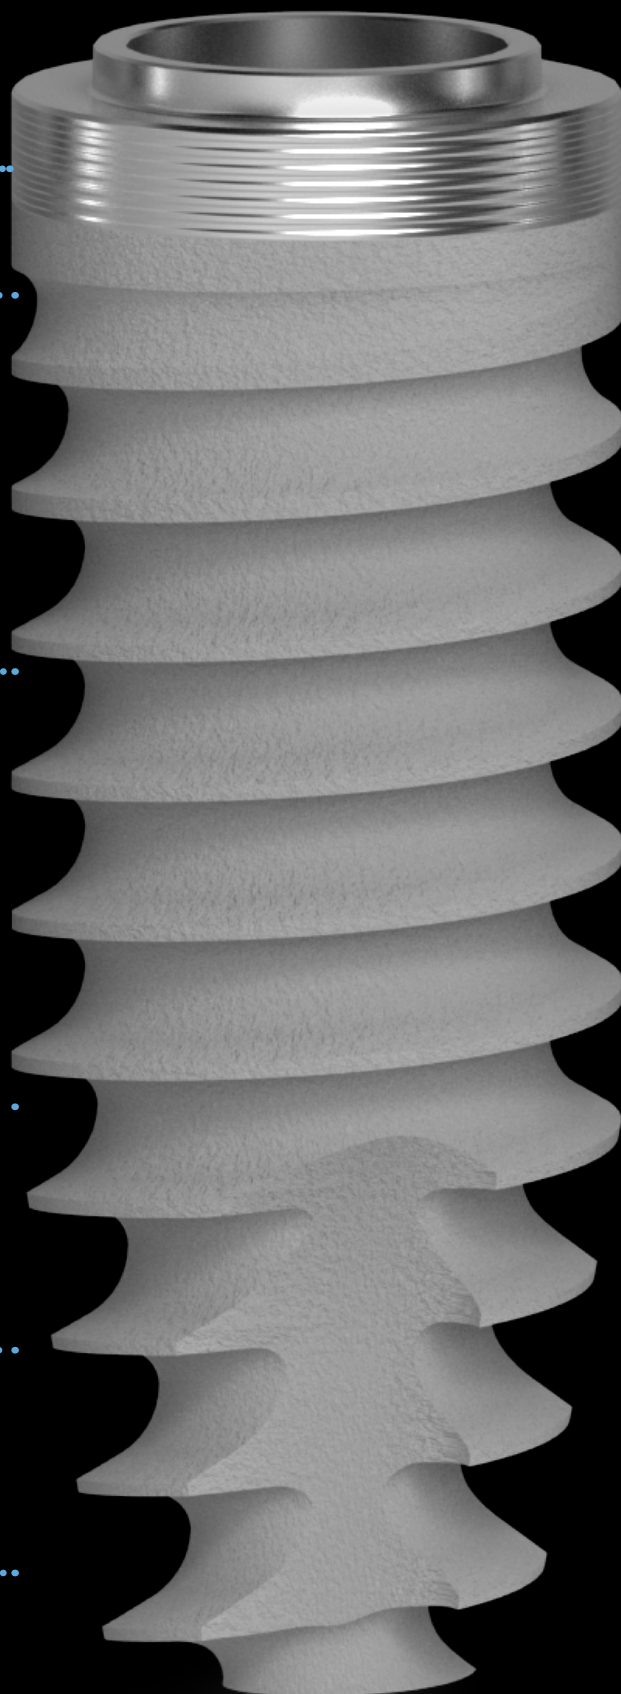Conic, cu o spirală mai adâncă pe toată lungimea, asigură stabilitate mai ales în cazurile post-extracționale



Shelta Power

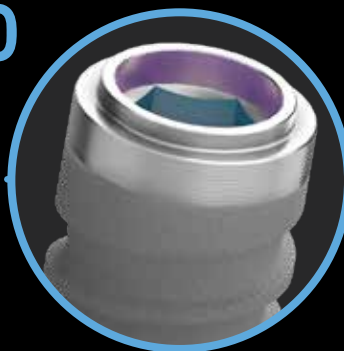Ø 3.80, Ø 4.25, Ø 5.00



**CONEXIUNE
COLLEX ONE**

comun tuturor
diametrelor pentru
o abordare protetică
simplificată

MORFOLOGIE CORONARĂ

care face inserarea precisă și
crește stabilitatea primară în
maxilarul superior



**CORE CONIC ȘI
SPIRĂ CONICĂ**

permite o sensibilitate
excelentă în timpul
inserării



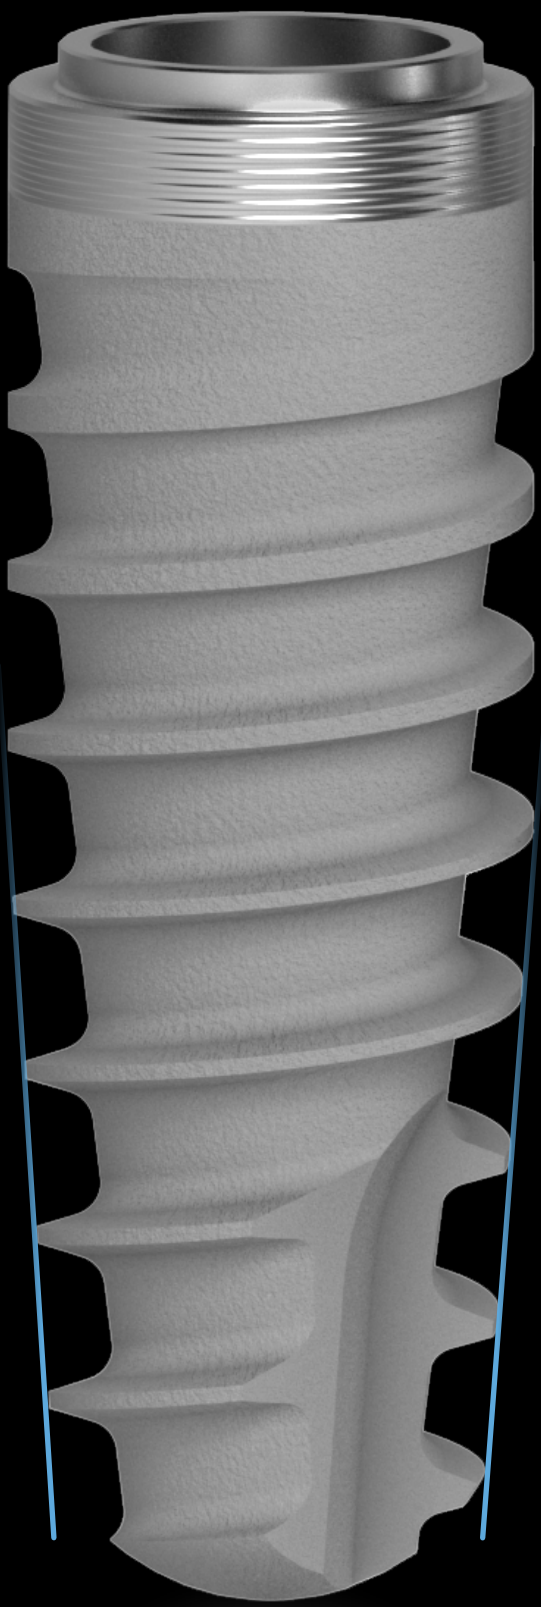
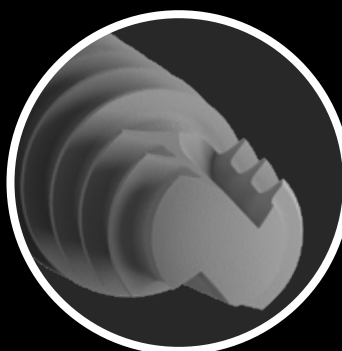
FILETARE

cu îngroșare progresivă pentru
a crește condensarea osului
slab mineralizat




APEX

rotunjit, perfect pentru
sinus lift





Shelta SL Power

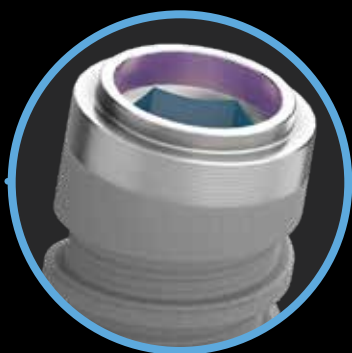Ø 3.80, Ø 4.25, Ø 5.00



GÂT UTM

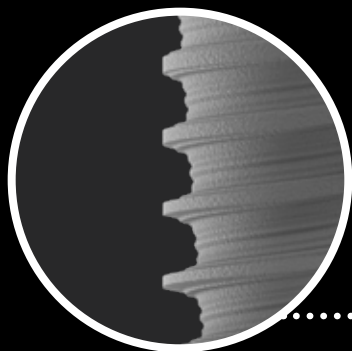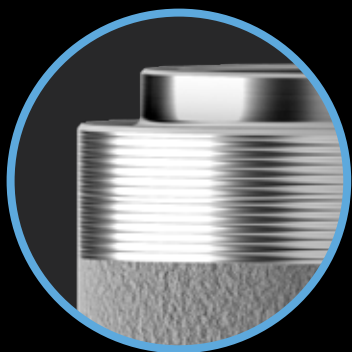Suprafața concepută
pentru zona de interfață
dintre țesuturile moi și
țesuturile dure




**SPIRĂ LARGĂ ȘI
CANELURI ÎN CORE**

pentru o stabilitate primară
mai mare și pentru a crește
suprafața de contact când osul
este mai puțin dens




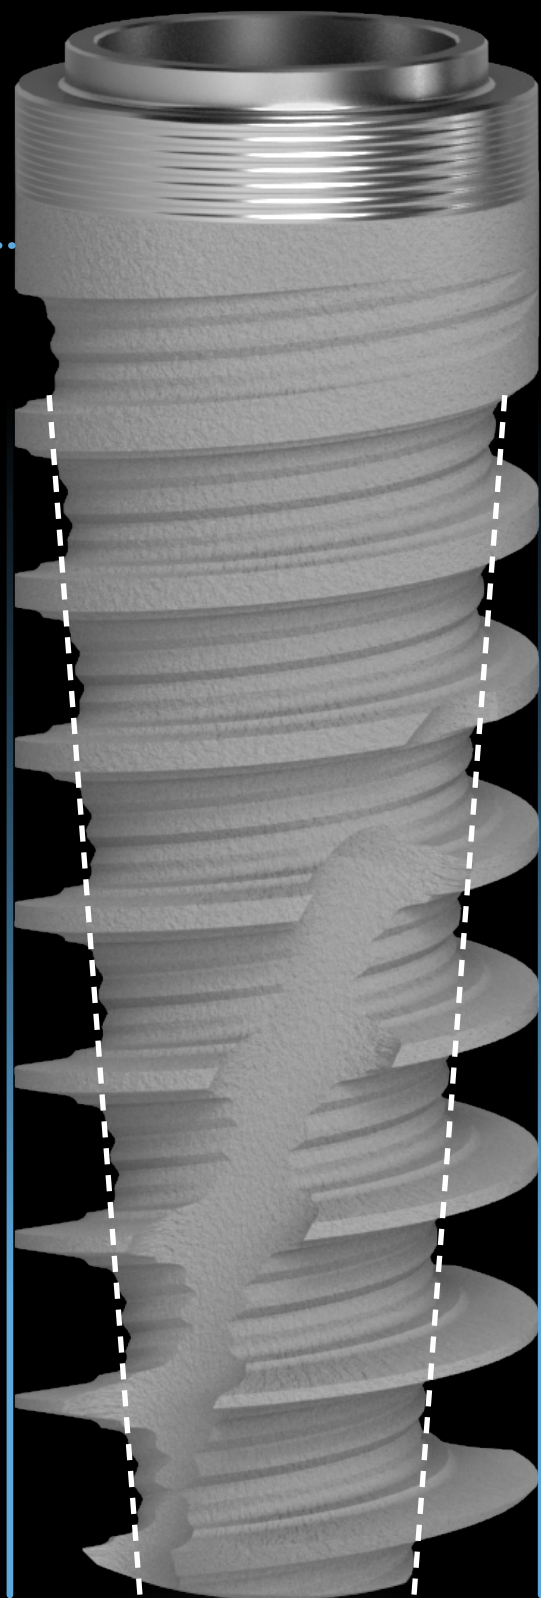**CANAL APICAL
ELICOIDAL**



UTM și ZirTi: două suprafețe în sinergie

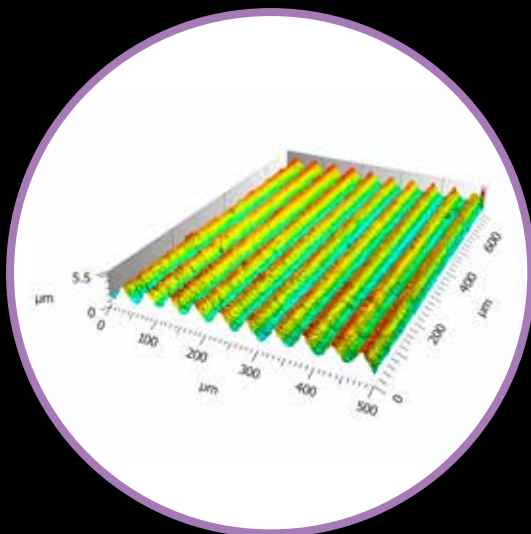
Suprafață UTM: substratul



Nu este o suprafață prelucrată, ci este o microfiletare regulată care conferă dimensiunea corectă pentru a potența organizarea celulară.

Sa: 0,6 μm

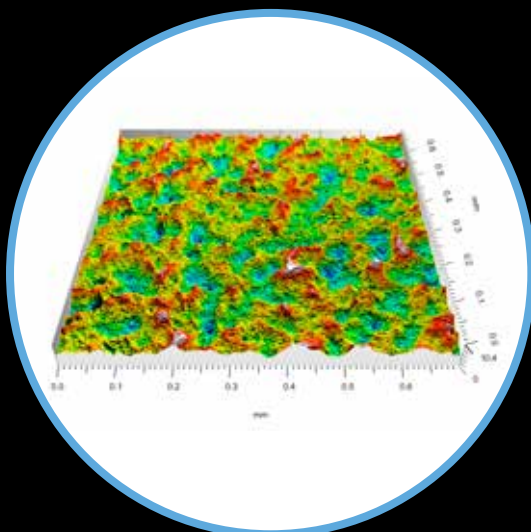Suprafața ZirTi: este ideală




Suprafața ZirTi este obținută printr-un proces de sablare cu oxid de zirconiu, urmat de o tratare cu acid, care conferă o topografie la care osteoblastele s-au dovedit a se adapta perfect și care stimulează o proliferare rapidă.


Sa: 1,4-1,7 μm

Istologia la om la 3 luni: chiar și în osul D4 se observă o mineralizare excelentă la contactul cu suprafața ZirTi.

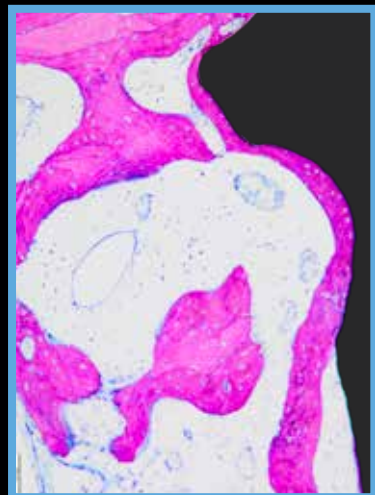Imagine oferită prin amabilitatea prof. M.Gargari, dr. A.Rocci.




conceput pentru țesuturile moi

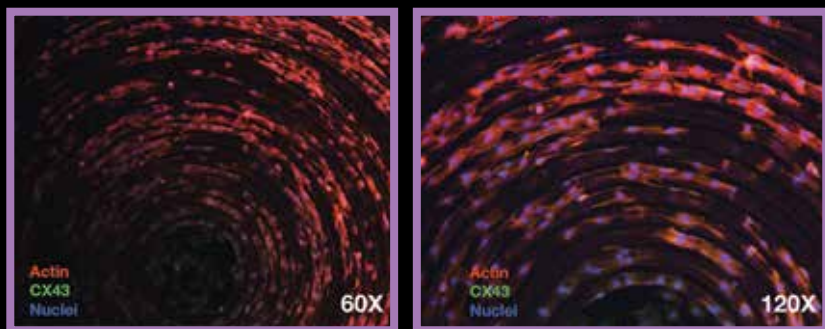

Dispunerea fibroblastelor pe suprafața UTM după 72 de ore, observate cu microscopie cu fluorescență.

Micro-striațiile prezente pe gâtul implantului oferă o ghidare pentru mișcarea unidirecțională a celulelor, cu **beneficiul biologic al unei depuneri mai rapide, organizate și orientate a fibrelor de collagen**. Beneficiul clinic rezultat este un proces de **vindecare mai rapidă** și o menținere pe termen lung a **țesuturilor sănătoase și stabile** în timp.

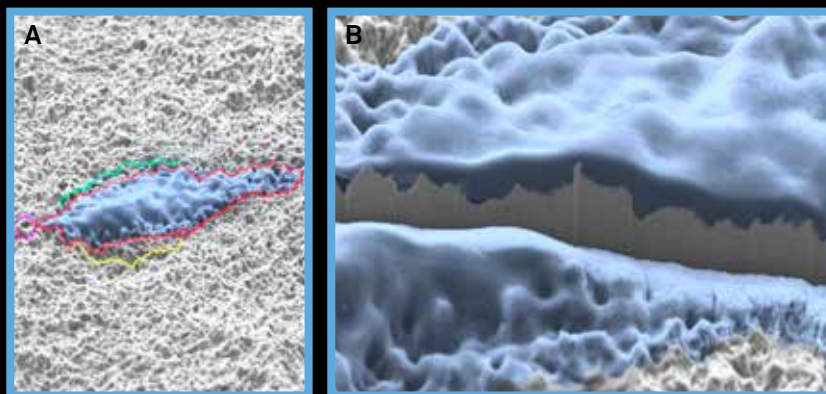pentru osteointegrare



Mărituri ale osteoblastelor primare pe suprafața ZirTi: în imaginile A și B este vizibilă **adaptarea intimă a unei celule pe vârfurile** care caracterizează ZirTi, datorită unei secțiuni obținute cu FIB (Focused Ion Beam).

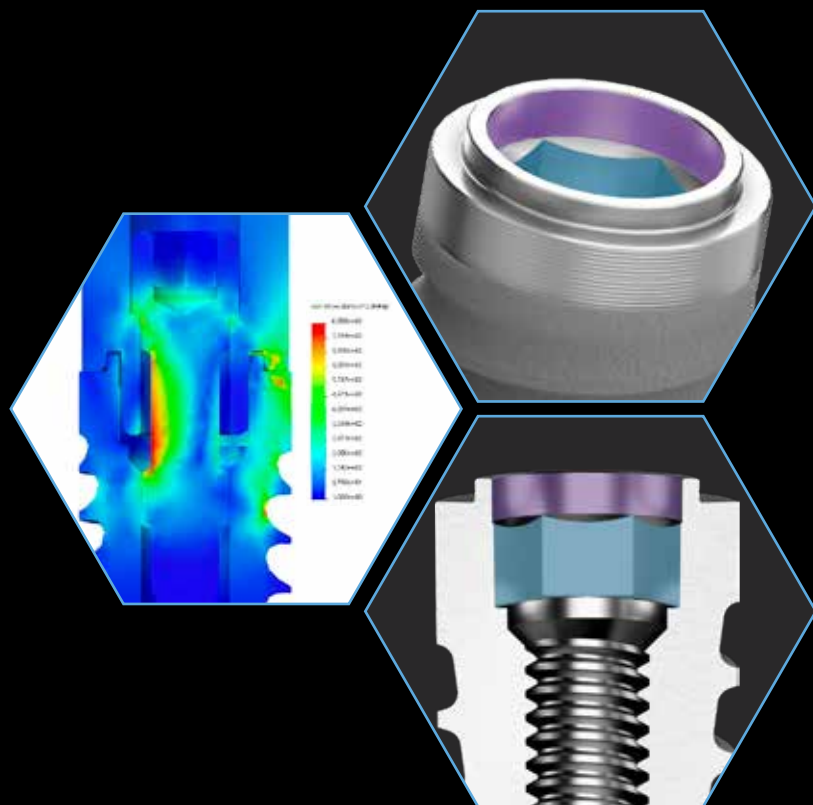
Imagine oferită prin amabilitatea Prof. Macaluso, Universitatea din Parma, Departamentul de Medicină și Chirurgie - Centrul de Odontologie.



Bibliografie despre
suprafața ZirTi

Avantajele

CONEXIUNII UNICE COLLEX



CONEXIUNE COLLEX ONE:

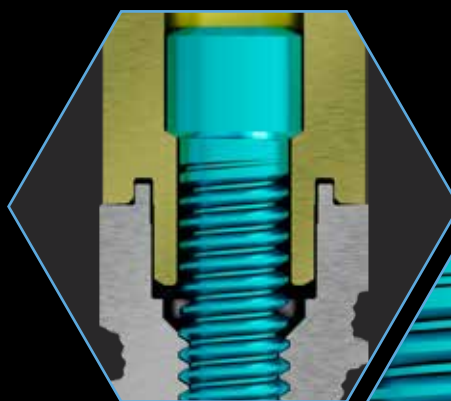
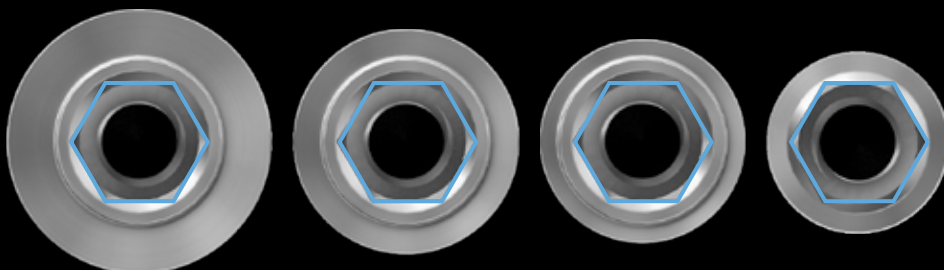
diverse studii i-au documentat robustețea și stabilitatea protetică în comparație cu alte conexiuni fără guler.



Bibliografie despre conexiune Collex


Conexiune la **HEXAGON INTERN** cu un guler identic pentru toate diametrele.

PATRU DIAMETRE DIFERITE unite printr-o singură conexiune.



SIGILIU CONTRACONE:

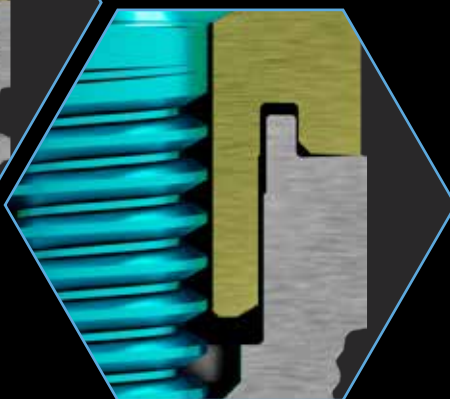- prelucrare micromecanică specială care face ca ambele suprafețe să fie conice și să se sprijine reciproc;
- Sigiliu periferic care limitează infiltrarea bacteriană;
- Documentat în literatură.





Shelta Power SL $\varnothing$ 5.00 mm
cu pilon $\varnothing$ 3.80 mm



Shelta Power SL $\varnothing$ 5.00 mm
cu pilon $\varnothing$ 4.25 mm




Shelta Power SL $\varnothing$ 5.00 mm
cu pilon $\varnothing$ 5.00 mm

Posibilitatea de **PLATFORM SWITCHING** protetic, cu un pilon de diametru mai mic decât implantul, sau de proteză tradițională, cu un pilon de diametru congruent cu platforma de conexiune.

Posibilitatea de a monta componente de diametre diferite pe aceeași platformă permite obținerea **DIFERITELOR MISMATCHING**, pentru a obține beneficiile biologice și clinice ale platform switching-ului, fără a compromite rezistența mecanică.

$\varnothing$ implant	3.30 ●	3.80 ●	4.25 ●	5.00 ●
	3.30 ●	3.30 ●	3.30 ●	3.30 ●
$\varnothing$ componentă protetică compatibilă	-	3.80 ●	3.80 ●	3.80 ●
	-	-	4.25 ●	4.25 ●
	-	-	-	5.00 ●

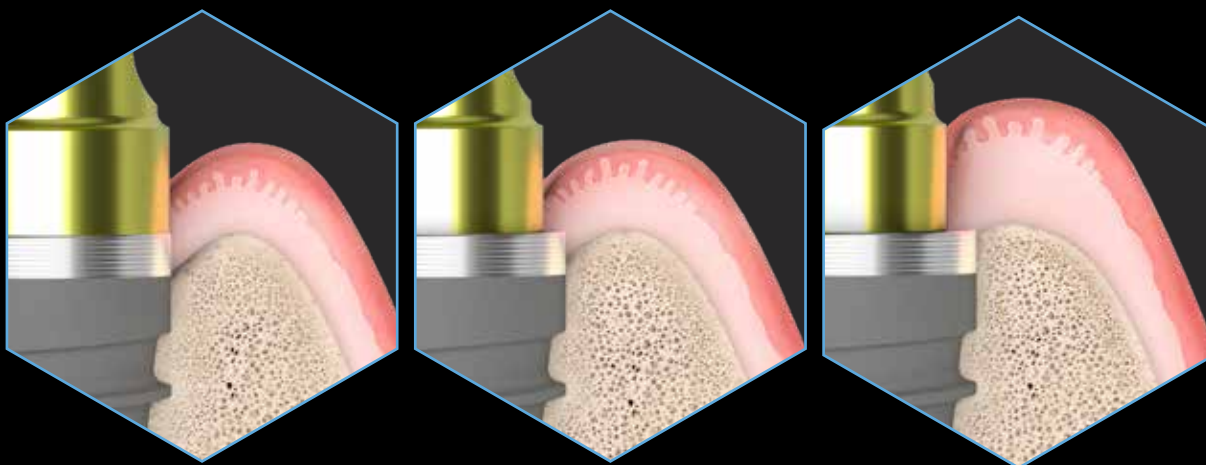

După cum s-a demonstrat în literatură, există o corelație între extinderea Platform Switching-ului (mismatching) și păstrarea dimensiunilor osului marginal: cu cât mismatching-ul este mai mare, cu atât sunt mai mari volumele de țesut dur și moale păstrate în jurul implantului.



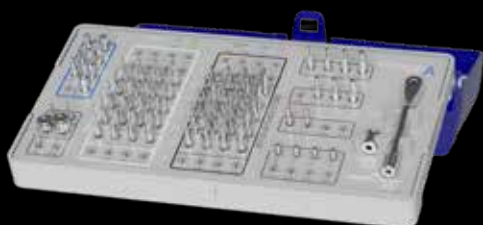
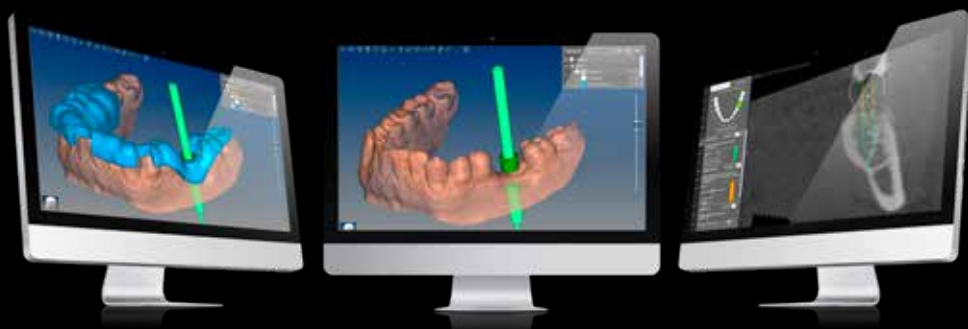
FLUX DIGITAL DE LUCRU

CU PREMIUM POWER ȘI SHELTA POWER:


tot ce este necesar pentru a economisi timp, a crește predictibilitatea tratamentelor și a spori productivitatea cabinetului și laboratorului



Chirurgie ghidată



ECHOPLAN PRO A

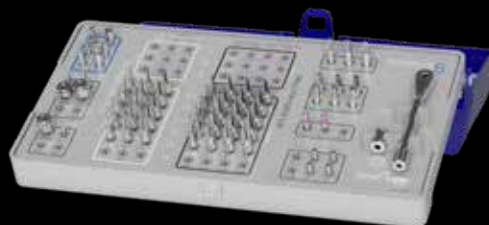

ECHOPLAN PRO S

Kituri complete dedicate chirurgiei ghidate: frezele cu stop integrat permit economisirea timpului și obținerea unor rezultate predictibile. Pentru detalii despre conținutul kiturilor pentru chirurgie ghidată cu care se pot insera Premium Power și Shelta Power, consultați pag. 25 și următoarele.

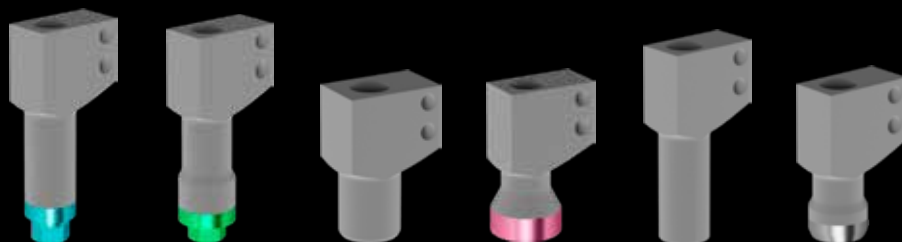


FREZE CU STOP INTEGRAT

Particularitatea frezelor Echoplan PRO este că nu trebuie atașate la stopurile de adâncime, deoarece includ deja un plan de stop vertical integrat în morfologia frezei. De asemenea, canelurile de pe corpul-ghid al frezei permit un flux mai mare de soluție fiziologică în interiorul pregătirii și reduc frecarea dintre freză și bușca de ghidaj. Rezultă o optimizare a timpilor chirurgicali, precum și o pregătire a sitului în deplină siguranță.



Achiziție de date




Posibilitatea de a prelua amprenta la nivelul platformei implantare sau al abutmentului, inclusiv pentru linii protetice speciale precum Conico, Plain B-Space și XA.




Noi analogi digitali: permit o repoziționare unică și stabilă în modelele realizate prin imprimare 3D, datorită integrării lor în librăriile CAD.



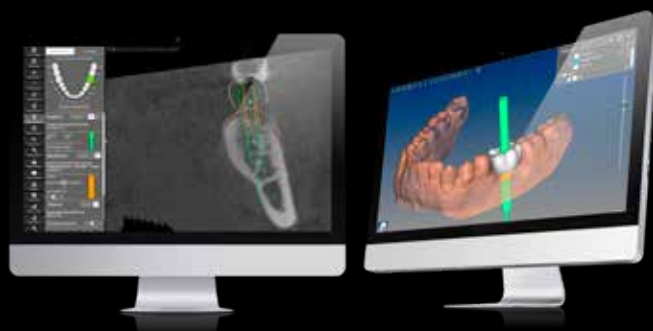PROIECTARE CAD



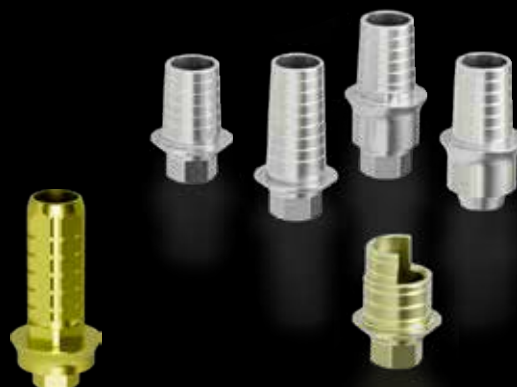O gamă largă de T-Connect pentru reabilitări singulare și multiple, cu con de cimentare de diferite înălțimi și personalizabile, cu orificiu pentru șurub drept și înclinat, permit găsirea pentru fiecare caz a suportului cel mai potrivit pentru structura frezată. Pentru detalii despre T-Connect disponibile pentru conexiunea Collex One, consultați pag. 53 și următoarele.




Ergonomia

Proceduri chirurgicale

KITURILE CHIRURGICALE sunt complete, compacte, ergonomice și conțin toate instrumentele necesare pentru chirurgia implanturilor **Premium Power** și **Shelta Power**.

Codurile de culoare, prezente și pe trusele chirurgicale, ghidează secvența corectă de utilizare a instrumentelor.


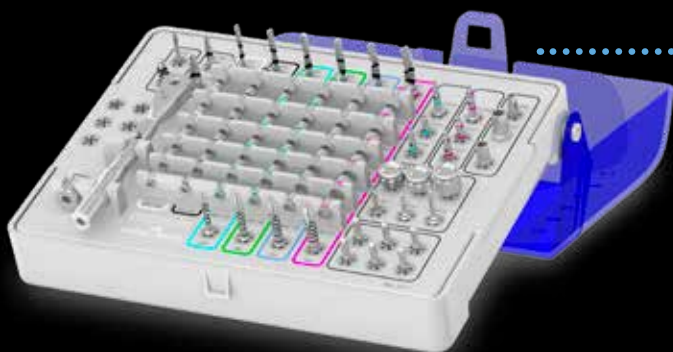
Atât frezele, cât și stopurile sunt caracterizate de un cod de culoare care ghidează operatorii în alegerea instrumentelor.



TRUSELE CHIRURGICALE sunt realizate din **Radel**, un polimer care nu își modifică proprietățile nici după numeroase cicluri de spălare și sterilizare în autoclavă.

FREZELE CILINDRICE sau **CONICE**, în funcție de diferitele pregătiri, sunt furnizate complete cu stopuri de adâncime.

Frezele sunt din **oțel inoxidabil** pentru uz chirurgical și își mențin caracteristicile neschimbate pentru mult timp și multe utilizări.



Frezele sunt caracterizate prin prezența unor **marcaje de adâncime** bine vizibile.

Frezele sunt **foarte ascuțite, centrate și performante**. Morfologia frezelor conice permite colectarea de os prețios pentru necesitățile de regenerare.





Kitul conține o **CHEIE PRACTICĂ**, care poate fi folosit atât ca și cheie fixă, cât și ca o cheie dinamometrică, utilă pentru controlul cuplului de inserare a implanturilor și înșurubarea șuruburilor protetice.

- Cuplul poate fi reglat între 10 și 70 Ncm;
- Reglarea cuplului este extrem de precisă deoarece fiecare cheie este calibrată individual.

Este inclusă o gamă largă de **CHEIȚE PROTETICE** atât pentru utilizare digitală, cât și cu cheia dinamometrică sau cu micromotorul.

Gama este potrivită pentru diversele necesități de acces la cavitatea orală, de la instrumente extra scurte la instrumente mai lungi pentru reabilitări protetice de tip Toronto.

Cuplarea ușor conică dintre cheie și șurub permite o retenție adecvată pentru transportul în siguranță al acestuia în cavitatea orală.



Procedura chirurgicală presupune o abordare fără montaj care garantează vizibilitate și ergonomie cu utilizarea driverelor brevetați **EASY INSERT**:

- este ușor de îndepărtat din zona implantară chiar și în prezența unor cupluri de inserare ridicate;
- designul dodecagonal previne deformările la colțurile conexiunilor, garantând menținerea preciziei și stabilității protetice;
- disponibil în kit în diferite configurații, atât pentru utilizare cu micromotorul, cât și cu cheia;
- instrumentele prezintă un hexagon pe tijă, aliniat cu hexagonul conexiunii, pentru a facilita orientarea rotațională a fixture-ului.

Kit Premium Power

Kit chirurgical complet cu instrumentele necesare pentru inserarea implanturilor Premium Power (cod. ZPREMIUM-ONE-INT).

Toate instrumentele pot fi achiziționate individual ca piese de schimb.

- 1**

Freza lanceolată
FS-230


- 2**

Freze intermediare*
◦ FG-200/280XS
• FG-330/425XS


- 3**

Freza pilot*
• FPT3-200-LXS


- 4**

Freza intermediară
ø 2,50 mm*
◦ FFT3-250-LXS



- 20**
- Adaptor pentru instrumente**
cu prindere hexagonală
AVV3-MAN-DG
- 

- 19**

Cheie dinamometrică
CRI5-KIT


- 18**

Freze Countersink
• A-FCC-380
• A-FCC-425
• A-FCC-500



- 17**
- Stop pentru freze cilindrice FFT3-425-LXS**
- STOP4-425-070
 - STOP4-425-085
 - STOP4-425-100
 - STOP4-425-115
 - STOP4-425-130
 - STOP4-425-150
- 

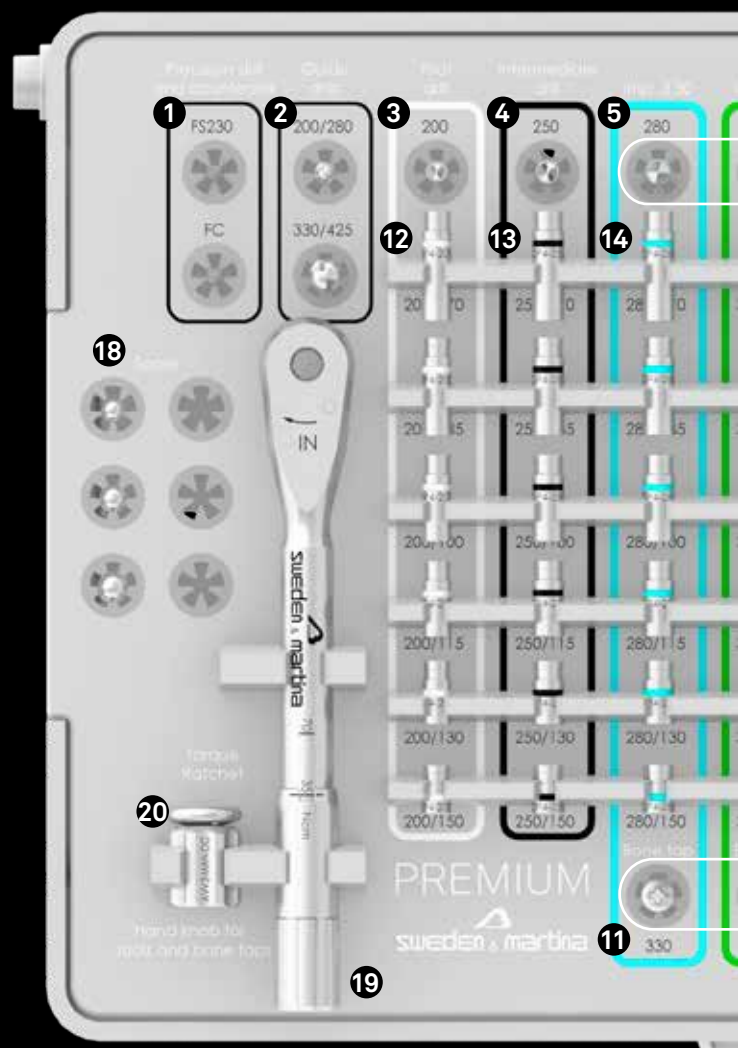
- 16**
- Stop pentru freze cilindrice FFT3-340-LXS**
- STOP4-340-070
 - STOP4-340-085
 - STOP4-340-100
 - STOP4-340-115
 - STOP4-340-130
 - STOP4-340-150
- 

- 15**
- Stop pentru freze cilindrice FFT3-300-LXS**
- STOP4-300-070
 - STOP4-300-085
 - STOP4-300-100
 - STOP4-300-115
 - STOP4-300-130
 - STOP4-300-150
- 

- 14**
- Stop pentru freze cilindrice FFT3-280-LXS**
- STOP4-280-070
 - STOP4-280-085
 - STOP4-280-100
 - STOP4-280-115
 - STOP4-280-130
 - STOP4-280-150
- 

- 13**
- Stop pentru freză intermediară ø 2,50 mm**
- STOP4-250-070
 - STOP4-250-085
 - STOP4-250-100
 - STOP4-250-115
 - STOP4-250-130
 - STOP4-250-150
- 

- 12**
- Stop pentru freză pilot**
- STOP4-200-070
 - STOP4-200-085
 - STOP4-200-100
 - STOP4-200-115
 - STOP4-200-130
 - STOP4-200-150
- 





AS-TRAY-INT casetă pentru instrumente din Radel.

18 *Vedeți pagina 31 pentru avertismentele referitoare la dimensiunile instrumentelor

5

Freze cilindrice finale*

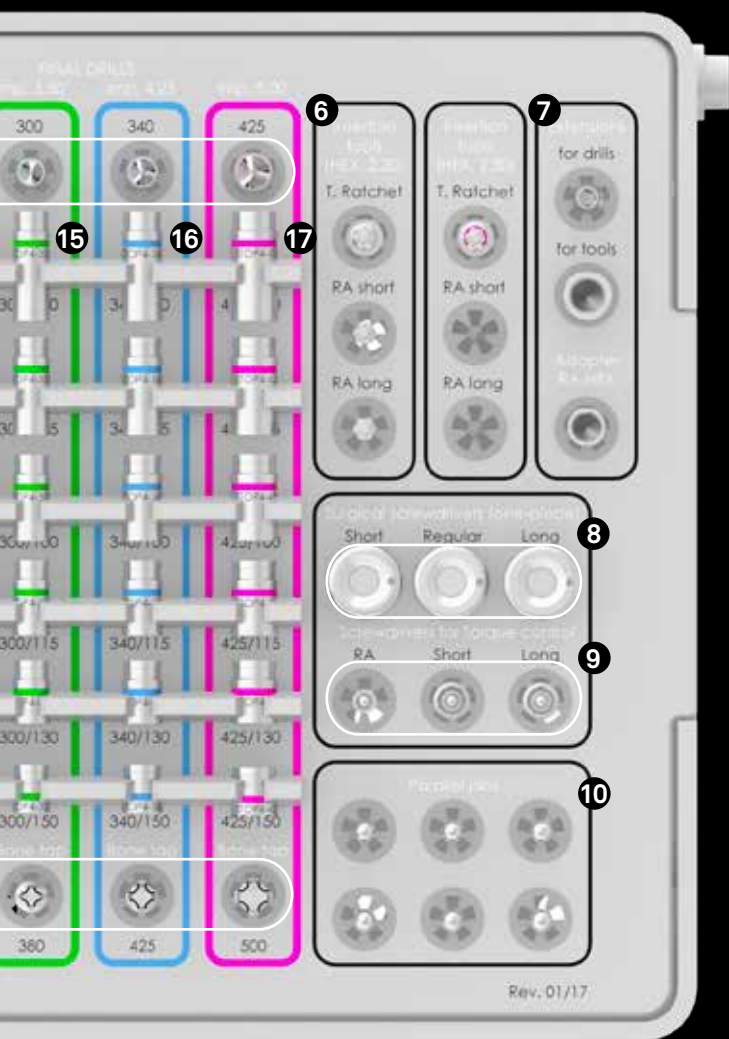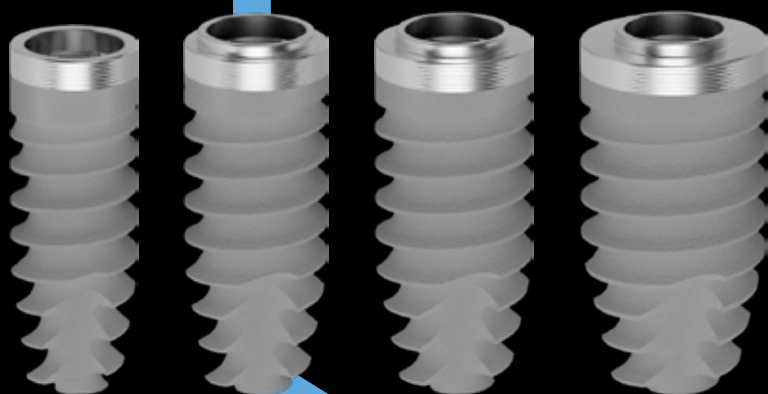- FFT3-280-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 3,30 mm
- FFT3-300-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 3,80 mm
- FFT3-340-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 4,25 mm
- FFT3-425-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 5,00 mm



6

Driver pentru inserarea implanturilor Easy Insert EASYC4-EX230-CA



EASYL4-EX230-CA



EASY4-EX230-EX



7

Prelungitoare și adaptor PROF-CAL3

Prelungitor pentru freze chirurgicale



BPM-15

Prelungitor pentru instrumente cu conexiune hexagonală



B-AVV-CA3

Adaptor cu prindere pentru contraunghi pentru instrumente cu conexiune hexagonală



11

Filetatoare*

- SM-MS-330 pentru implanturi $\varnothing$ 3,30 mm
- A-MS-380 pentru implanturi $\varnothing$ 3,80 mm
- A-MS-425 pentru implanturi $\varnothing$ 4,25 mm
- A-MS-500 pentru implanturi $\varnothing$ 5,00 mm



10

Pini de paralelism PPTL-2-28



9


Cheițe protetice HSM-20-CA



HSM-20-EX



HSML-20-EX




8


Cheițe chirurgicale digitale HSMXS-20-DG



HSM-20-DG



HSML-20-DG



Șabloane radiografice incluse în kit, pot fi comandate separat cu codurile AS-L100 (dimensiuni reale), AS-L120 (dimensiuni mărite cu 20%), AS-L130 (dimensiuni mărite cu 30%).

Kit Shelta Power

Kit chirurgical complet cu instrumentele necesare pentru inserarea implanturilor Shelta Power (cod. ZSHELTA-INT).

Toate instrumentele pot fi achiziționate individual ca piese de schimb.

1



Freza lanceolată
FS-230

2



Freza pilot
• CSR-FP-200

3



Freza intermediară $\varnothing$ 2,50 mm
• SE-FK250

4



Freza finală cilindrică și stopurile aferente
• FFT3-280-LXS
• CSR-STOP4-280-085
• CSR-STOP4-280-100
• CSR-STOP4-280-115
• CSR-STOP4-280-130
• CSR-STOP4-280-150

22



Tarodator
• SM-MS-330-CA pentru implanturi Premium One $\varnothing$ 3,30 mm

20



Cheie dinamometrică
CRI5-KIT

21



Tarozi
• SH-MS-380-CA pentru implanturi $\varnothing$ 3,80 mm
• SH-MS-425-CA pentru implanturi $\varnothing$ 4,25 mm
• SH-MS-500-CA pentru implanturi $\varnothing$ 5,00 mm

18

Cheie chirurgicale digitale
HSMXS-20-DG



HSM-20-DG



HSM-20-EX



HSM-20-DG

19



Adaptor pentru instrumente cu prindere pentru contraunghi
AVV-CA-DG-EX

17

Cheie protetice
HSM-20-CA



HSM-20-CA



HSM-20-EX



HSM-20-DG



HSM-20-EX

16

Prelungitoare
PROF-CAL3
Prelungitor pentru freze chirurgicale



BPM-15

Prelungitor pentru instrumente cu conexiune hexagonală



15

Pini de paralelism
PPTL-2-28



14


Easy Insert Hex. 2.30 mm
EASYC4-EX230-CA



EASYL4-EX230-CA



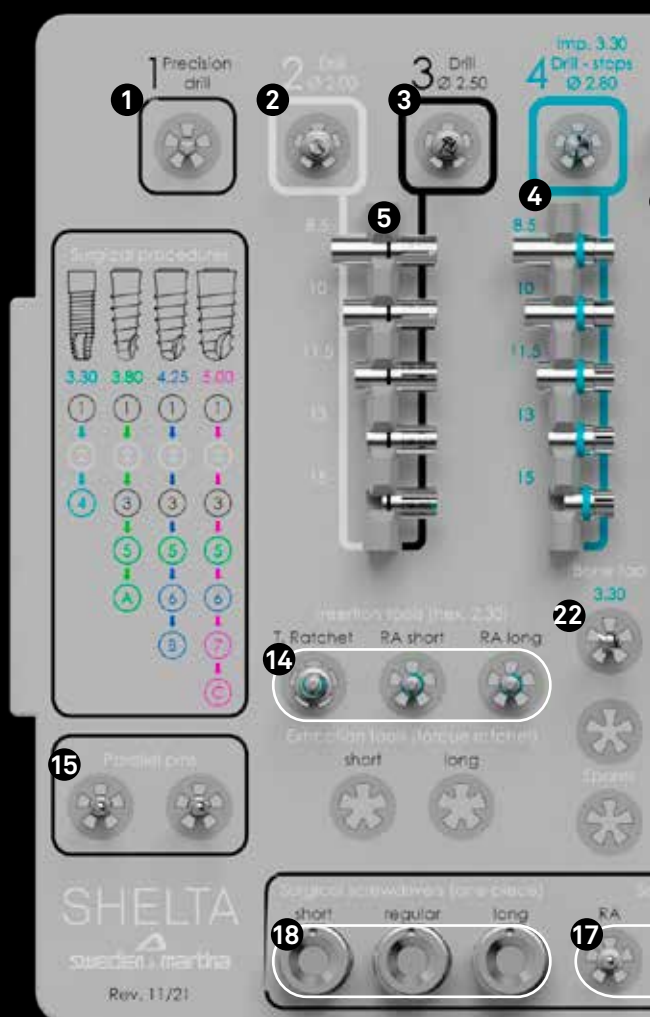EASY4-EX230-EX



SH-TRAY-INT casetă pentru instrumente din Radel.

*Vedeți pagina 31 pentru avertismentele referitoare la dimensiunile instrumentelor

5



Stop pentru freza pilot și intermediară

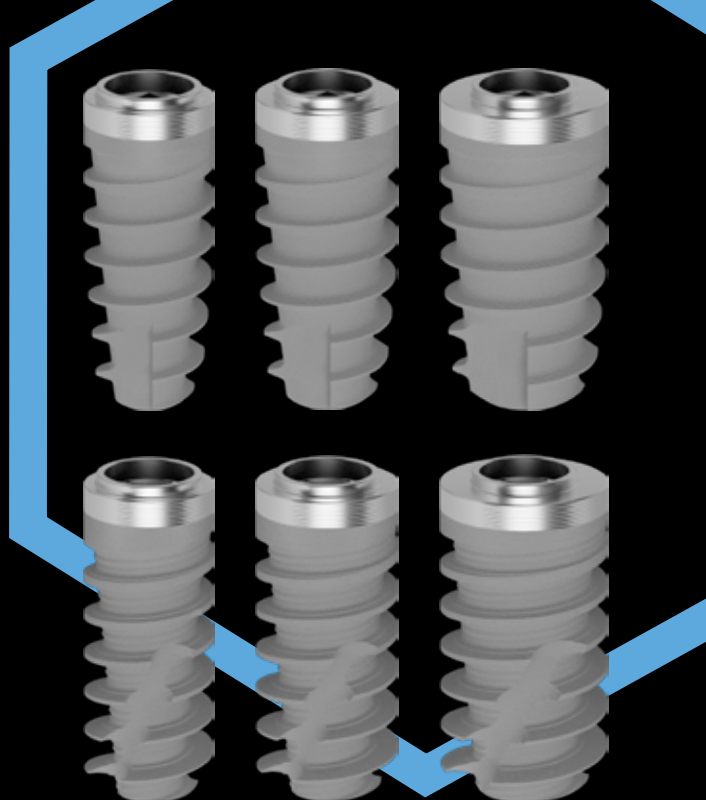
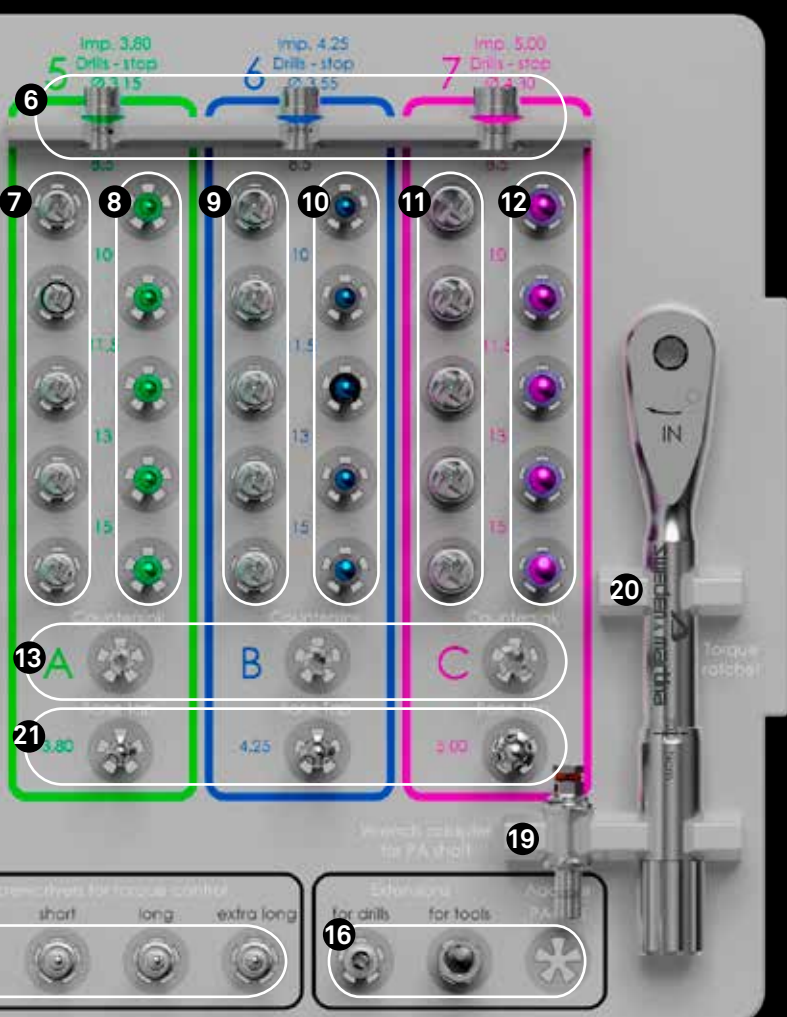
- CSR-STOP-2028-085
- CSR-STOP-2028-100
- CSR-STOP-2028-115
- CSR-STOP-2028-130
- CSR-STOP-2028-150

6



Stop pentru freze conice

- SH-STOP4-FK380
- SH-STOP4-FK425
- SH-STOP4-FK500



7



Freze finale conice pentru implanturi $\varnothing$ 3.80 mm

- SH-FK380-085
- SH-FK380-100
- SH-FK380-115
- SH-FK380-130
- SH-FK380-150

8



Replici

- SH-380-085-RP
- SH-380-100-RP
- SH-380-115-RP
- SH-380-130-RP
- SH-380-150-RP

9



Freze finale conice pentru implanturi $\varnothing$ 4.25 mm

- SH-FK425-085
- SH-FK425-100
- SH-FK425-115
- SH-FK425-130
- SH-FK425-150

13



Freze Countersink

- A-FCC-380
- A-FCC-425
- A-FCC-500

12



Replici

- SH-500-085-RP
- SH-500-100-RP
- SH-500-115-RP
- SH-500-130-RP
- SH-500-150-RP

11



Freze finale conice pentru implanturi $\varnothing$ 5.00 mm

- SH-FK500-085
- SH-FK500-100
- SH-FK500-115
- SH-FK500-130
- SH-FK500-150

10



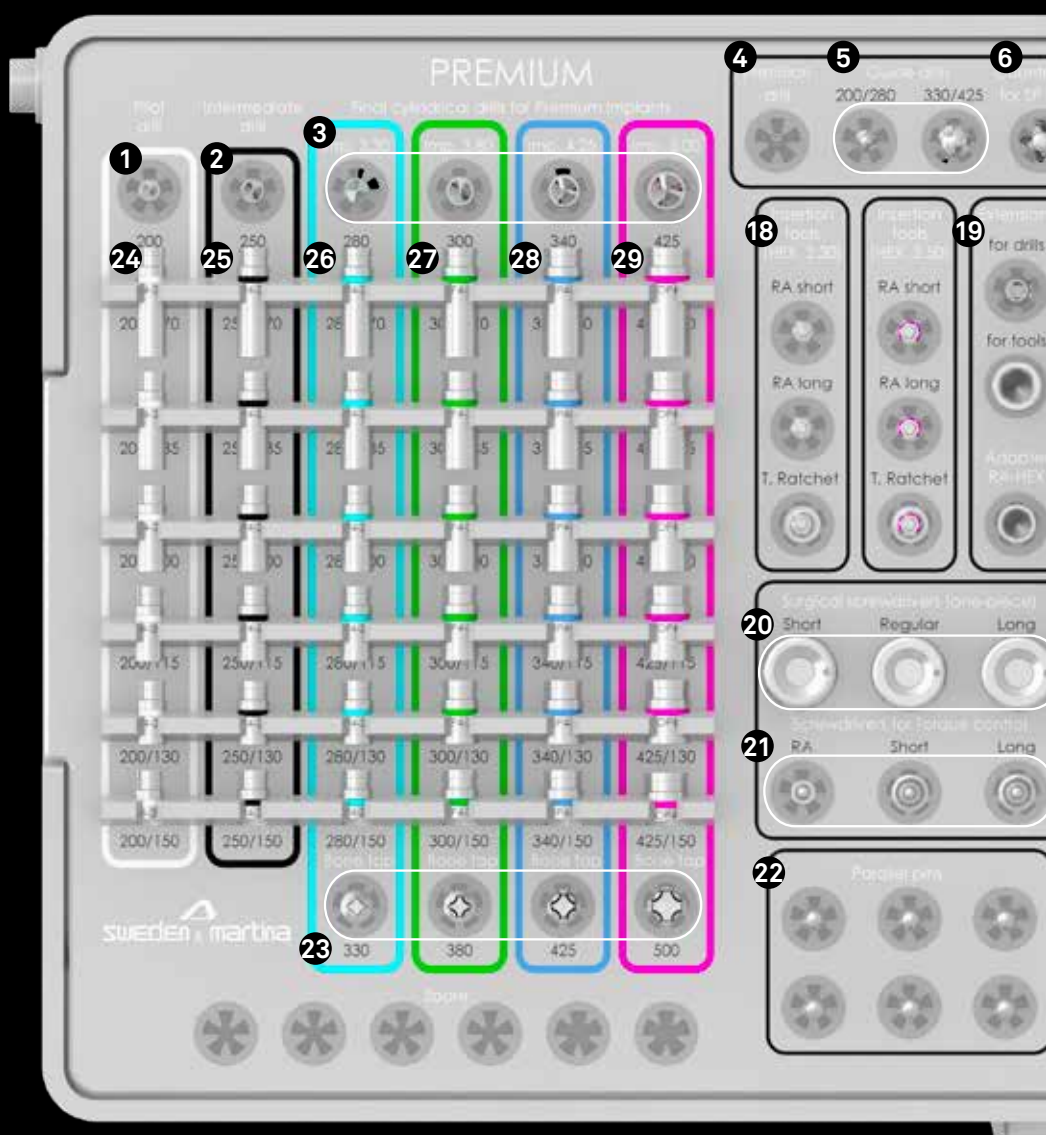



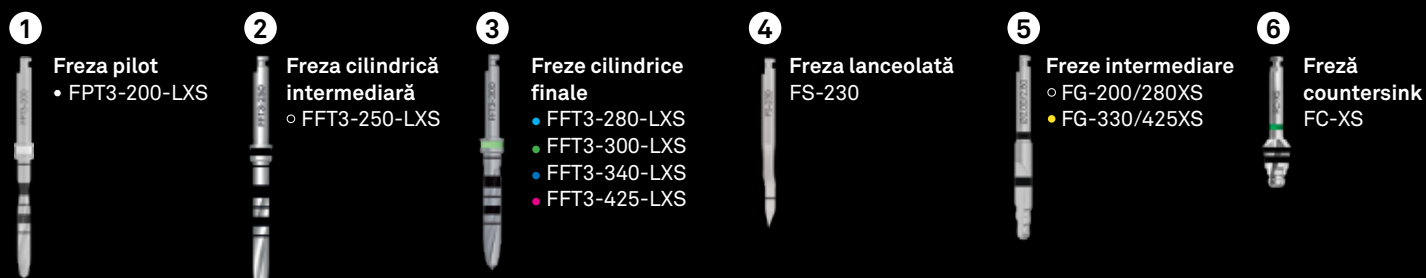
Replici

- SH-425-085-RP
- SH-425-100-RP
- SH-425-115-RP
- SH-425-130-RP
- SH-425-150-RP

Filme radiografice incluse în kit, pot fi comandate separat cu codurile SH-L100 (dimensiuni reale), SH-L120 (dimensiuni mărite cu 20%), SH-L130 (dimensiuni mărite cu 30%).

Kit combinat Premium Shelta Power

Kit chirurgical complet cu instrumentele necesare pentru inserarea implanturilor Premium Power și Shelta Power (cod. ZPRESH-INT).



ASH-TRAY-INT casetă pentru instrumente din Radel.

22 *Toate instrumentele din Kitul Combi sunt prezente și în cele două kituri Premium Power la pag. 18 și 19 și Shelta Power la pag. 20 și 21

7

Freză conică intermediară
• SE-FK250



8

Stop pentru freze conice
• SH-STOP4-FK380
• SH-STOP4-FK425
• SH-STOP4-FK500



9

Stop pentru freză conică intermediară
• CSR-STOP-2028-085
• CSR-STOP-2028-100
• CSR-STOP-2028-115
• CSR-STOP-2028-130
• CSR-STOP-2028-150



10

Freze finale conice
• SH-FK380-085
• SH-FK380-100
• SH-FK380-115
• SH-FK380-130
• SH-FK380-150



11

Replici
• SH-380-085-RP
• SH-380-100-RP
• SH-380-115-RP
• SH-380-130-RP
• SH-380-150-RP



12

Freze finale conice
• SH-FK425-085
• SH-FK425-100
• SH-FK425-115
• SH-FK425-130
• SH-FK425-150



13

Replici
• SH-425-085-RP
• SH-425-100-RP
• SH-425-115-RP
• SH-425-130-RP
• SH-425-150-RP



14

Freze finale conice
• SH-FK500-085
• SH-FK500-100
• SH-FK500-115
• SH-FK500-130
• SH-FK500-150



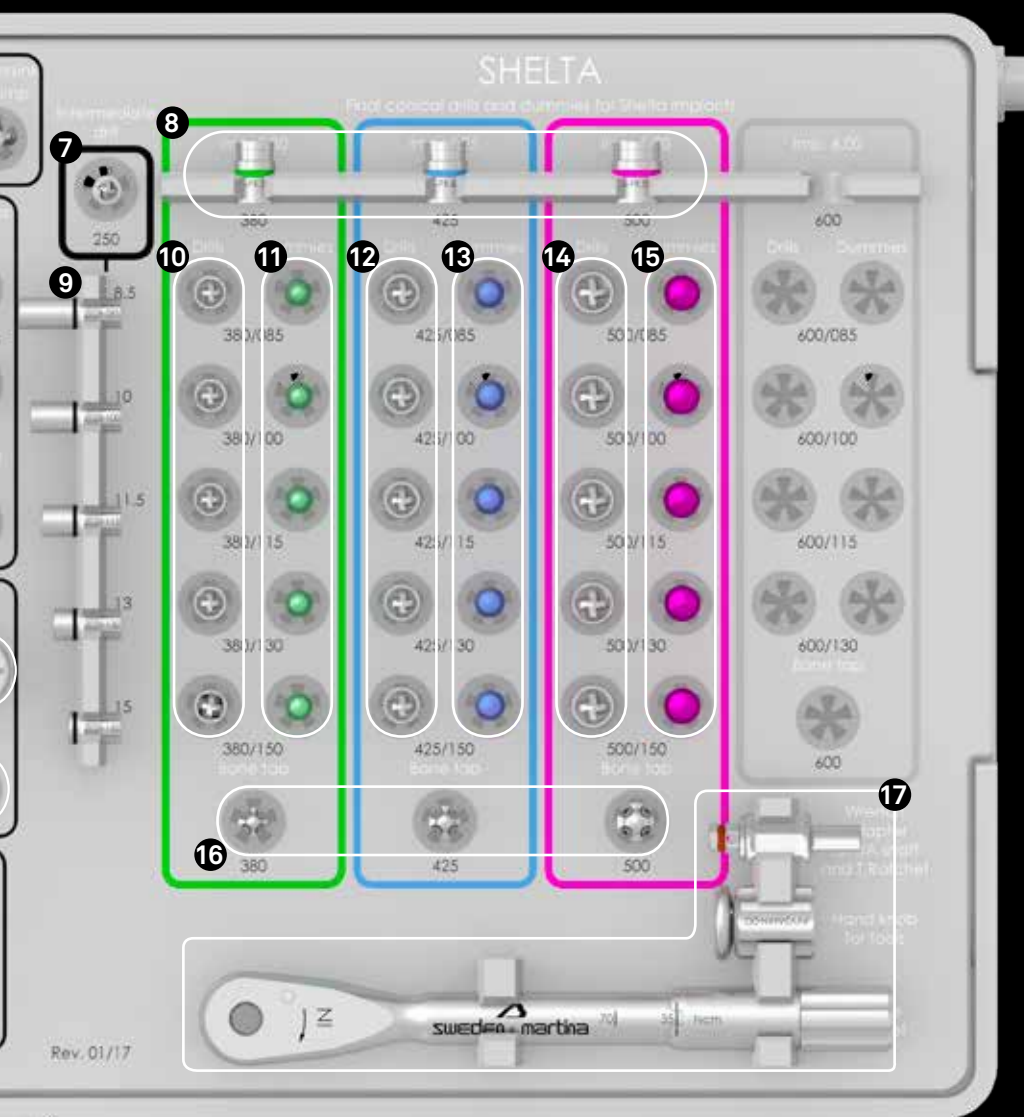
15

Replici
• SH-500-085-RP
• SH-500-100-RP
• SH-500-115-RP
• SH-500-130-RP
• SH-500-150-RP



16

Tarozii Shelta
• SH-MS-380-CA
• SH-MS-425-CA
• SH-MS-500-CA



20

Cheie chirurgicale digitale
HSMXS-20-DG



HSM-20-DG



HSML-20-DG



19

Prelungitoare și adaptor
PROF-CAL3



BPM-15



B-AVV-CA3



18

Easy Insert Hex. 2.30 mm
EASYC4-EX230-CA



EASYL4-EX230-CA




EASY4-EX230-EX



17

Adaptoare și cheie dinamometrică
AVV-CA-DG-EX



AVV3-MAN-DG










CRI5-KIT



Filme radiografice incluse în kit.

Kit chirurgical pentru chirurgia ghidată cu implanturi Premium Power

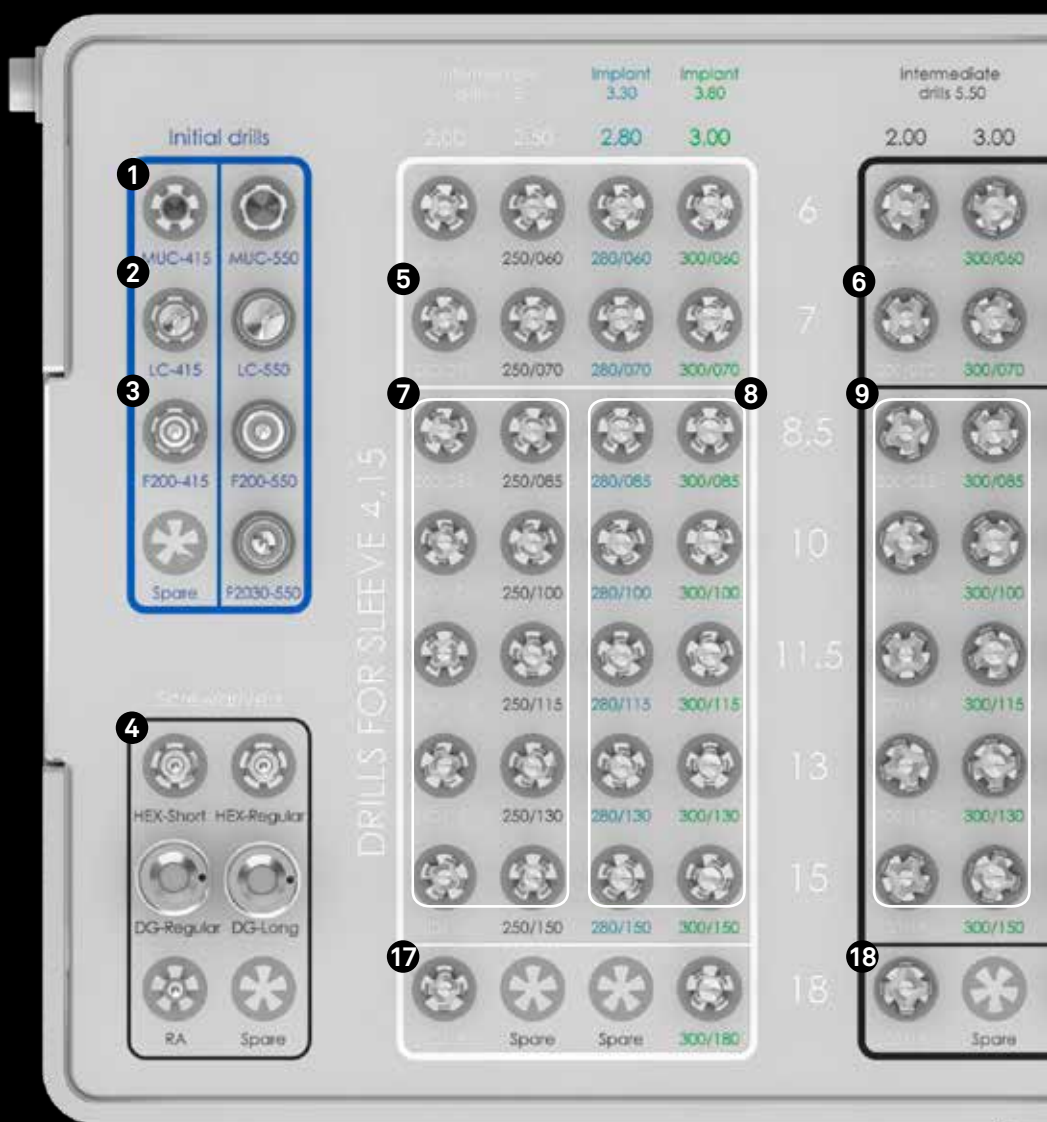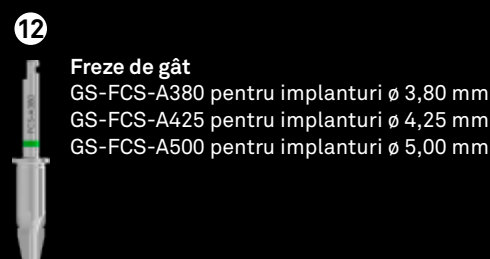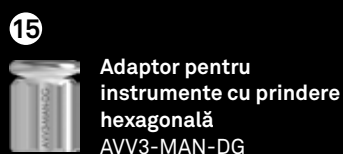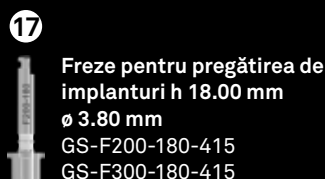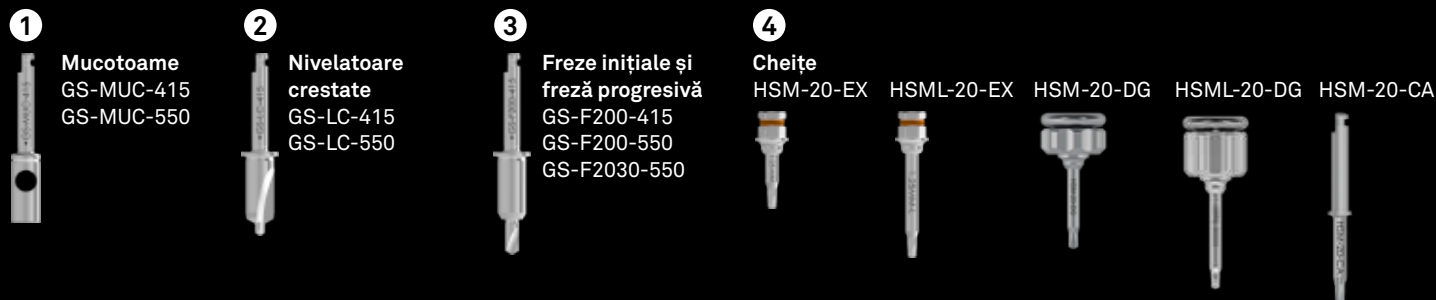Kit chirurgical complet cu instrumentele necesare pentru inserarea în chirurgia ghidată a implanturilor Premium Power (cod. ZGS-PRO-A-INT). În tray sunt prezente unele sloturi pentru instrumente aferente unor sisteme diferite. Aceste instrumente nu sunt, prin urmare, incluse în dotarea standard a kitului.



Frezele opționale pentru pregătirea implanturilor cu înălțimea de 7,00 mm pot fi comandate și cumulativ ca set suplimentar cu codul GS-PROA-INTEGRA-070.

5



**Freze opționale pentru implanturi
h 7,00 mm ϕ 3,80 mm**
GS-F200-070-415
GS-F250-070-415
GS-F280-070-415
GS-F300-070-415

6



**Freze opționale pentru implanturi
h 7,00 mm ϕ 4,25 și 5,00 mm**
GS-F200-070-550
GS-F300-070-550
GS-F340-070-550
GS-F425-070-550

7



**Freze intermediare pentru
sleeve ϕ 4,15 mm**
GS-F200-085-415
GS-F200-100-415
GS-F200-115-415
GS-F200-130-415
GS-F200-150-415

GS-F250-085-415
GS-F250-100-415
GS-F250-115-415
GS-F250-130-415
GS-F250-150-415

8



**Freze finale pentru
sleeve ϕ 4,15 mm**
GS-F280-085-415
GS-F280-100-415
GS-F280-115-415
GS-F280-130-415
GS-F280-150-415

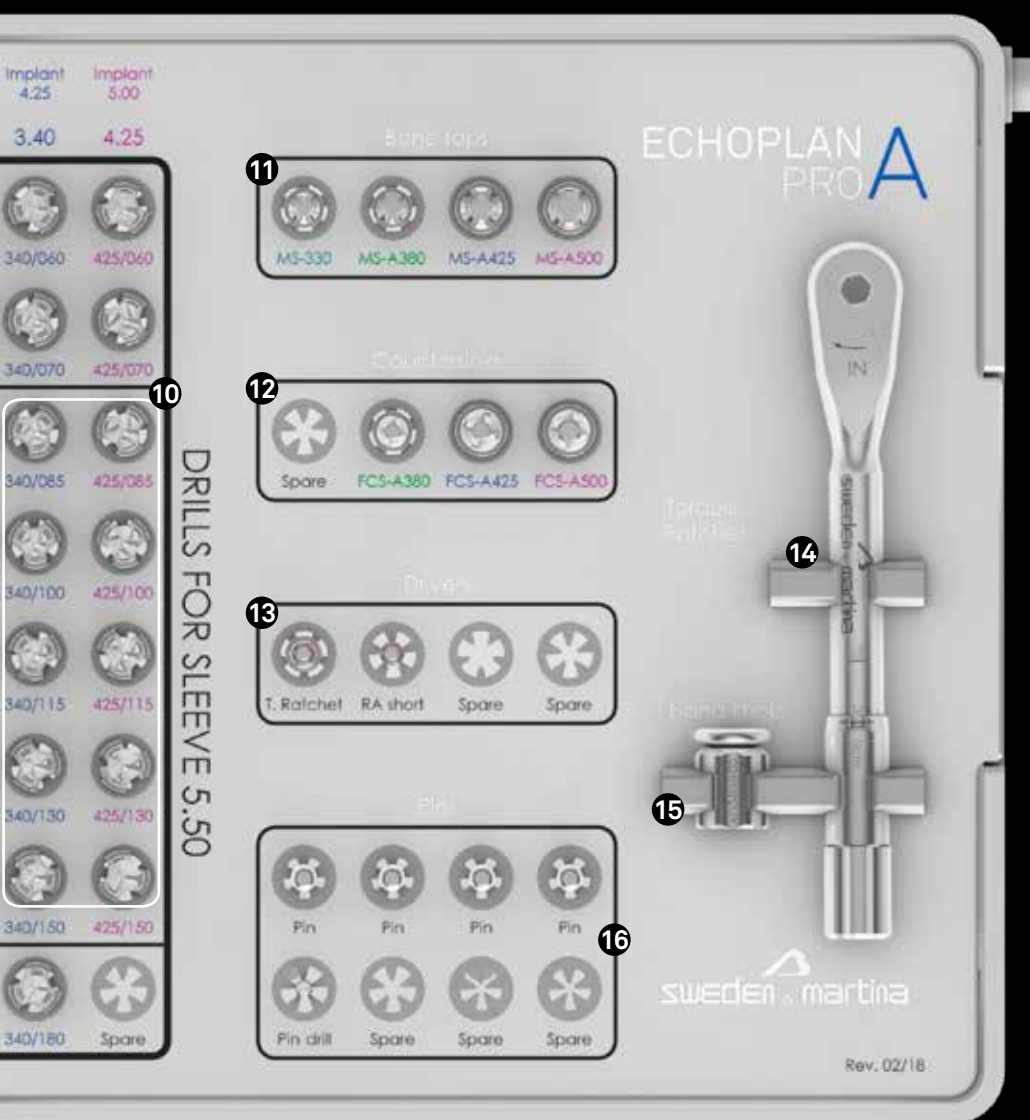
GS-F300-085-415
GS-F300-100-415
GS-F300-115-415
GS-F300-130-415
GS-F300-150-415

9



**Freze intermediare pentru
sleeve ϕ 5,50 mm**
GS-F200-085-550
GS-F200-100-550
GS-F200-115-550
GS-F200-130-550
GS-F200-150-550

GS-F300-085-550
GS-F300-100-550
GS-F300-115-550
GS-F300-130-550
GS-F300-150-550



11



Tarozii
GS-SM-MS-330 pentru implanturi ϕ 3,30 mm
GS-MS-A380 pentru implanturi ϕ 3,80 mm
GS-MS-A425 pentru implanturi ϕ 4,25 mm
GS-MS-A500 pentru implanturi ϕ 5,00 mm

10

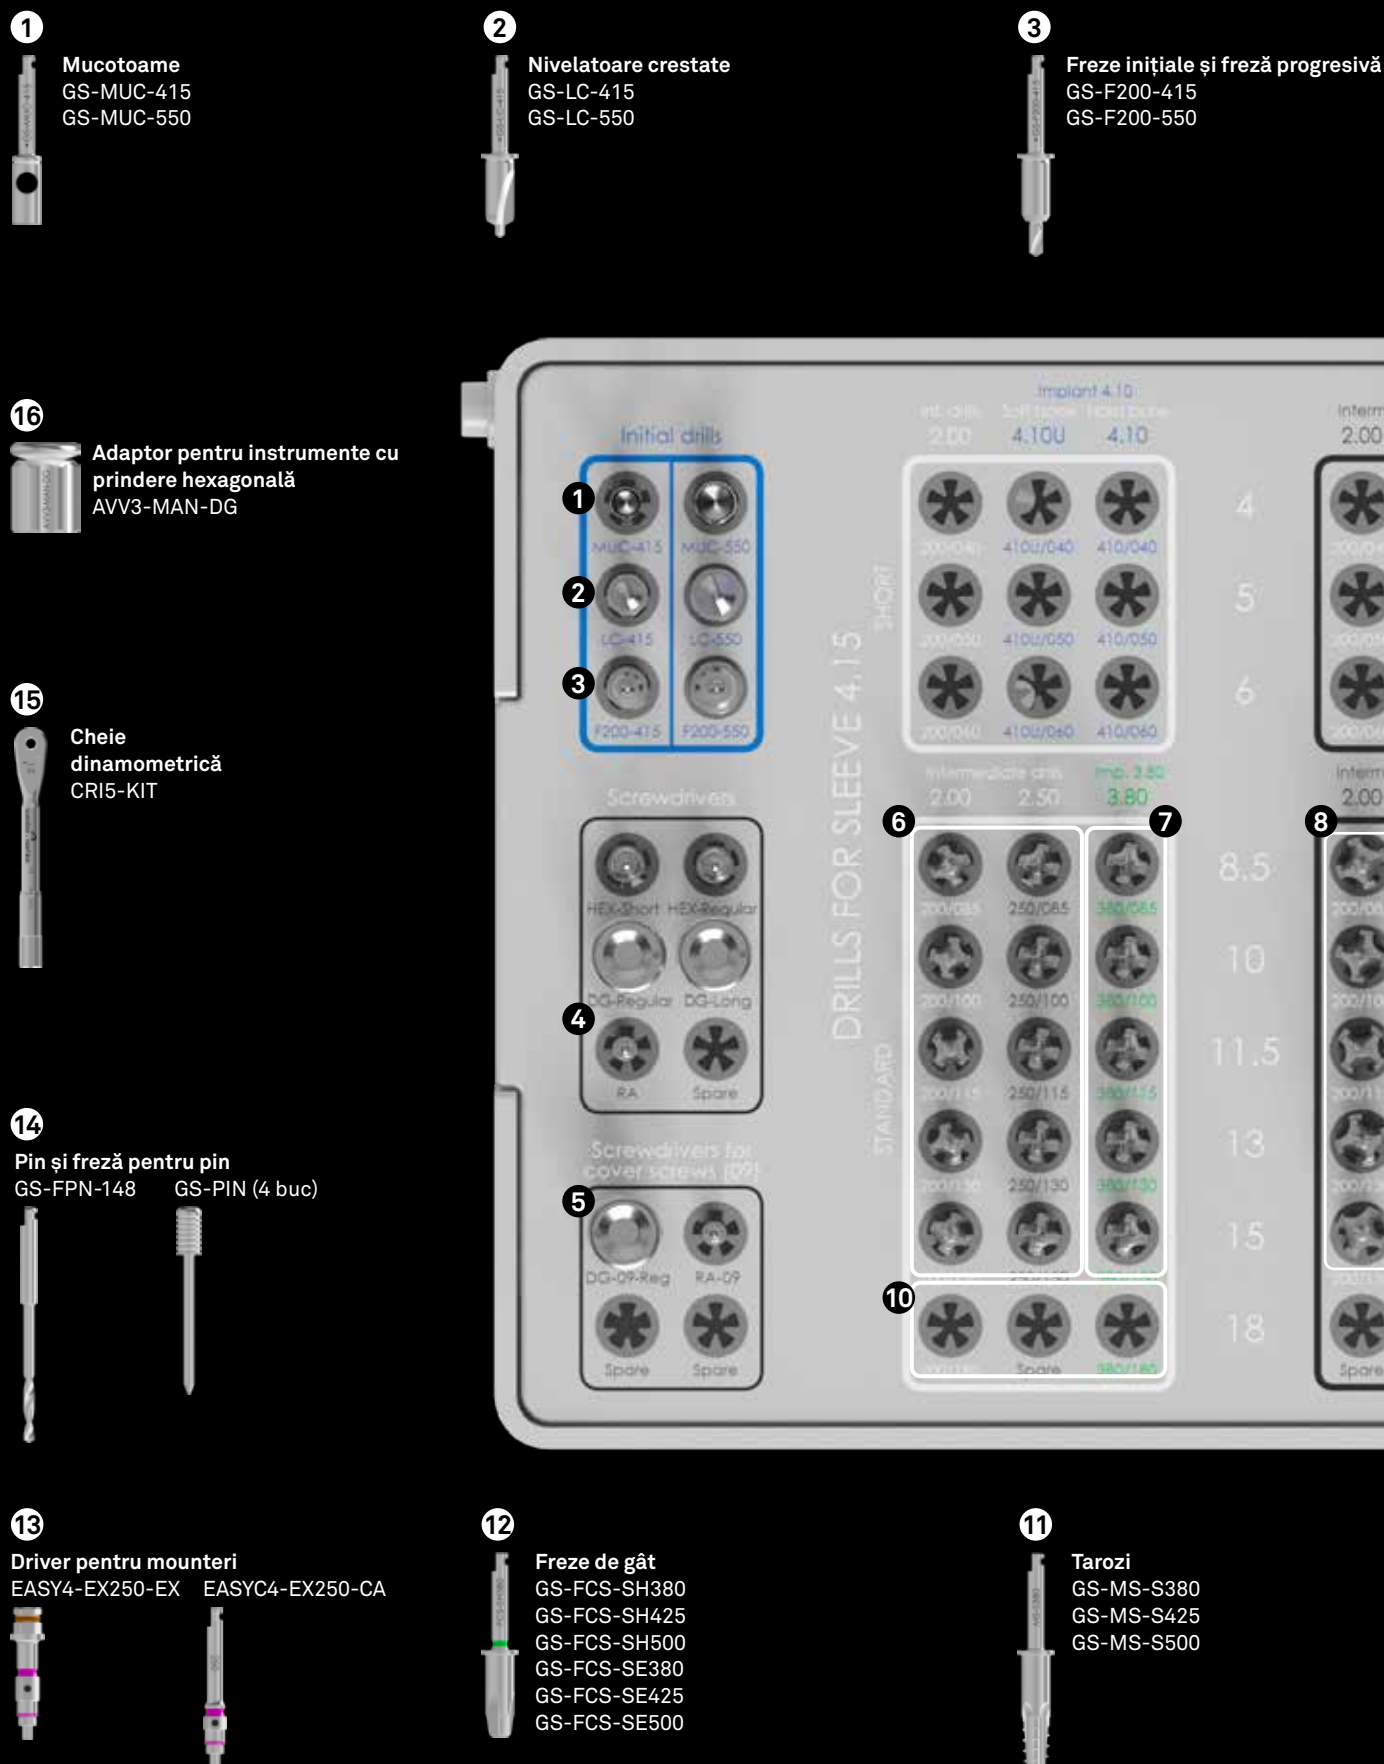


**Freze finale pentru implanturi ϕ
4,25 mm cu sleeve ϕ 5,50 mm**
GS-F340-085-550
GS-F340-100-550
GS-F340-115-550
GS-F340-130-550
GS-F340-150-550

**Freze finale pentru implanturi ϕ
5,00 mm cu sleeve ϕ 5,50 mm**
GS-F425-085-550
GS-F425-100-550
GS-F425-115-550
GS-F425-130-550
GS-F425-150-550

Kit chirurgical pentru chirurgia ghidată cu implanturi Shelta Power și Shelta SL Power

Kit chirurgical complet cu instrumentele necesare pentru inserarea în chirurgia ghidată a implanturilor Shelta Power și Shelta SL Power (cod. ZGS-PRO-S-INT). În tray sunt prezente unele sloturi pentru instrumente aferente unor sisteme diferite. Aceste instrumente nu sunt, prin urmare, incluse în dotarea standard a acestor kituri.



4

Cheițe

HSM-20-EX

HSML-20-EX

HSM-20-DG

HSML-20-DG

HSM-20-CA

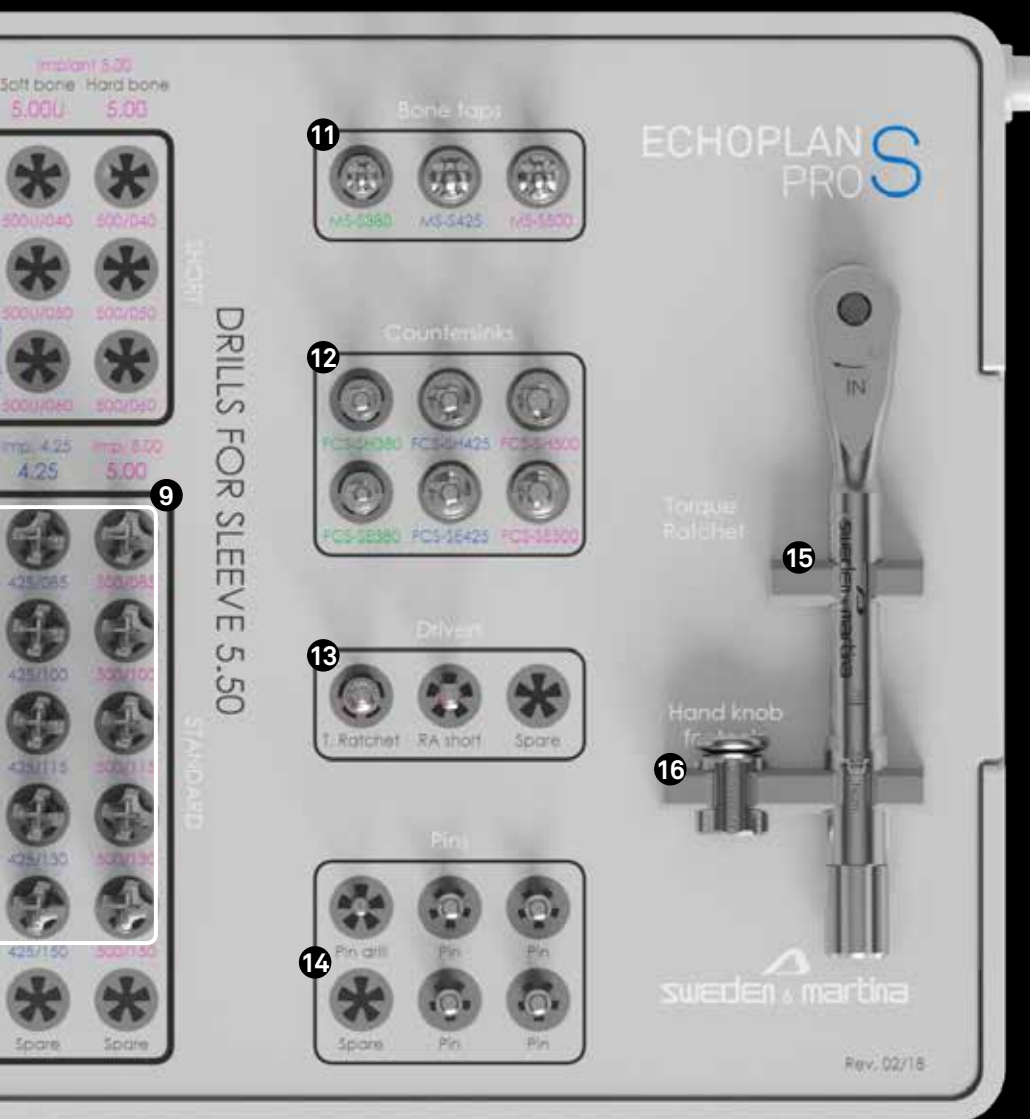



5

Cheițe pentru șuruburi chirurgicale de închidere

HSM-09-CA

HSM-09-DG



6

Freze intermediare pentru sleeve ø 4,15 mm

GS-F200-085-415

GS-F200-100-415

GS-F200-115-415

GS-F200-130-415

GS-F200-150-415

GS-FK250-085-415

GS-FK250-100-415

GS-FK250-115-415

GS-FK250-130-415

GS-FK250-150-415

7

Freze finale pentru sleeve ø 4,15 mm

GS-FK380-085-415

GS-FK380-100-415

GS-FK380-115-415

GS-FK380-130-415

GS-FK380-150-415

10

Freze opționale pentru implanturi h 18,00mm sleeve 4,15 mm

GS-F200-180-415

GS-FK380-180-415

9

Freze finale pentru sleeve ø 5,50 mm

GS-FK425-085-550

GS-FK425-100-550

GS-FK425-115-550

GS-FK425-130-550

GS-FK425-150-550

GS-FK500-085-550

GS-FK500-100-550

GS-FK500-115-550

GS-FK500-130-550

GS-FK500-150-550

8

Freze intermediare pentru sleeve ø 5,50 mm

GS-F200-085-550

GS-F200-100-550

GS-F200-115-550

GS-F200-130-550

GS-F200-150-550

GS-FK380-085-550

GS-FK380-100-550

GS-FK380-115-550

GS-FK380-130-550

GS-FK380-150-550

Componente pentru chirurgia ghidată

Sleeve și mounteri pentru chirurgia ghidată					
implanturi	ø	sleeve	mounter	șurub	easy mounter
Premium Power Slim	3.30	 4.00			 GS-EASY-AS-415-CA
		GS-B415-EX-6* GS-B415-EX-SET*			 GS-EASY-AS-415-EX
Premium Power și Shelta Power	3.80	 4.00			 GS-EASY-AS-415-CA
		GS-B415-EX-6* GS-B415-EX-SET*			 GS-EASY-AS-415-EX
Premium Power și Shelta Power	4.25 5.00	 4.00			 GS-EASY-AS-550-CA
		GS-B550-EX-6* GS-B550-EX-SET*			 GS-EASY-AS-550-EX

*Sleeve-urile de ghidaj indexate sunt disponibile în pachete de 6 bucăți și în seturi de 100 bucăți, nu se vând individual.
**Șurubul de strângere este furnizat împreună cu mounterul, dar poate fi comandat și separat ca piesă de schimb.

Instrumente chirurgicale opționale

Freze intermediare	Freza lanceolată lungă	Cilindru pentru construcția șablonului radiologic
		
FG-200/280XS	FSL-230	DIM

*din titan, de utilizat pentru ghidarea frezei lanceolate.

Freze pentru pregătirea implanturilor Premium Power de h 7.00 mm*			
freza pilot	freza intermediară Shorty		
			
FPS-200	FGS-200/300	FFS-300	FFS-340
	-		
STOPPS4-200-070	-	STOPPS4-300-070	STOPPS4-340-070

*Toate frezele pentru pregătire sunt incluse în kitul de freze ZSHORTY-INT, care conține și freze pentru pregătirea implanturilor mai scurte (h 5.00 mm și h 6.00 mm) din alte sisteme.

Freze pentru sectoare distale

ø 2.00



FPT5-200-LXS

ø 2.80



FFT5-280-LXS

ø 2.90



FFT5-290-LXS

ø 3.00



FFT5-300-LXS

ø 3.20



FFT5-320-LXS

ø 3.30



FFT5-330-LXS

ø 3.40



FFT5-340-LXS

ø 3.60



FFT5-360-LXS

ø 4.25



FFT5-425-LXS

ø 4.45



FFT5-445-LXS

Chei protetice care nu sunt incluse în kituri



HSMXL-20-EX

cu conexiune hexagonală, extra lung



HSMXS-20-CA

cu prindere pentru contraunghi, extra scurt



AVV-CAP-TIT-1

instrument pentru întreținerea căpăcelului din titan pentru atașamente sferice



BASCC-EX

pentru atașamente sferice, cu conexiune hexagonală



AVV2-ABUT

pentru bonturi P.A.D. drepte



8926-SW

pentru bont Locator, scurt



8927-SW

pentru bont Locator, lung



DSPDCLH-24

pentru orificiu înclinat, lungime 24 mm




DSPDCLH-32

pentru orificiu înclinat, lungime 32 mm

Pini de paralelism


ø 2.80 mm



PP-2/28

pin de paralelism cu o parte de ø 2,00 mm și cealaltă de ø 2.80 mm


ø 2.80 mm



PPTS-2-28

pin de paralelism cu creștături de adâncime, versiunea mică

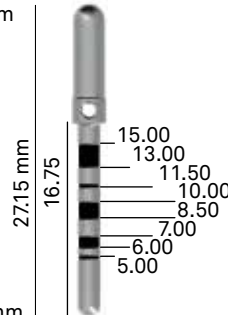
ø 2.80 mm



PPTL-2-28

pin de paralelism cu creștături de adâncime, versiunea mare

ø 2.80 mm



PPS-2/3

pin de paralelism pentru freze scurte cu creștături la 5,00, 6,00 și 7,00 mm

Tarozi cu conexiune hexagonală

	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
	SM-MSC-330	A-MSC-380	A-MSC-425	A-MSC-500
	-	SH-MS-380	SH-MS-425	SH-MS-500

Tarozi cu prindere pentru contraunghi

	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
	SM-MS-330-CA	A-MS-380-CA	A-MS-425-CA	A-MS-500-CA

Chei pentru îndepărtarea implanturilor

	BC-EX230	scurtă
	BL-EX230	lungă

Profilatoare osoase pentru bonturi P.A.D.

	h transmucos 3,00, larg			
	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
	A-PAD-PS330-L	A-PAD-PS380-L	A-PAD-PS425-L	A-PAD-PS500-L
	h transmucozală 5.00, îngust			
	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
	A-PAD-PS330-S	A-PAD-PS380-S	A-PAD-PS425-S	A-PAD-PS500-S
	ghid pentru profilator			
	A-PAD-GUI-PS-230			

Osteotomi conici cu vârf plat

				
ø 0.20	ø 0.90	ø 1.60	ø 2.00	ø 2.40
E-OS-020-PP	E-OS-090-PP	E-OS-160-PC	E-OS-200-PC	E-OS-240-PC
osteotom ø 0,20 vârf plat	osteotom ø 0,90 vârf plat	osteotom ø 1,60 vârf concav	osteotom ø 2,00 vârf concav	osteotom ø 2,40 vârf concav

Osteotomi conici cu vârf plat

	h	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
	8.50-10.00	SH-OS-380-100-PP	SH-OS-425-100-PP	SH-OS-500-100-PP
	11.50	SH-OS-380-115-PP	SH-OS-425-115-PP	SH-OS-500-115-PP
	13.00	SH-OS-380-130-PP	SH-OS-425-130-PP	SH-OS-500-130-PP
	15.00	SH-OS-380-150-PP	SH-OS-425-150-PP	SH-OS-500-150-PP

Osteotomi conici cu vârf rotund

	h	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
	8.50-10.00	SH-OS-380-100-PR	SH-OS-425-100-PR	SH-OS-500-100-PR
	11.50	SH-OS-380-115-PR	SH-OS-425-115-PR	SH-OS-500-115-PR
	13.00	SH-OS-380-130-PR	SH-OS-425-130-PR	SH-OS-500-130-PR
	15.00	SH-OS-380-150-PR	SH-OS-425-150-PR	SH-OS-500-150-PR

Cheie dinamometrică opțională cu pârghie de control



TWL



TWL-AVV-EX cheiță

Mounter de serviciu pentru proceduri cu impact



MOU-EX230 mounter



CM2 cheie fixă
mounter

Profondimetru



PROF3

O-ring de schimb



ORING180-088

Chei pentru îndepărtarea atraumatică a implanturilor



EXTR-IMP-S

mic



EXTR-IMP-M

mediu



EXTR-IMP-L

mare

**Extractorul nu este specific pentru conexiunea implantului, ci trebuie ales în funcție de implantul care trebuie îndepărtat.*

Marcaje de adâncime

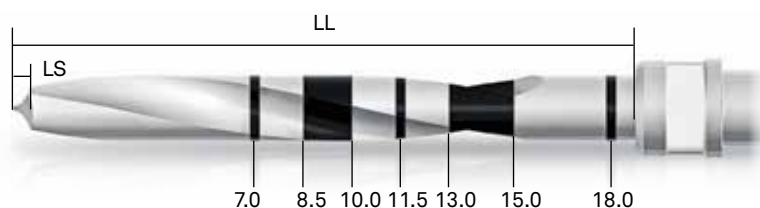
Marcajul laser prezent pe tășuri și utilizarea opritoarelor permit o pregătire în deplină siguranță și controlul adâncimii de inserare a instrumentului.

Frezele realizează întotdeauna un orificiu mai lung decât implantul care se dorește a fi inserat.




Supradimensionarea (LS) este egală cu înălțimea vârfului frezei care este utilizată.

LL: Lungimea totală a părții active, inclusiv vârful.

LS: Lungimea suprapregătirii. Această măsură trebuie calculată suplimentar față de lungimea orificiului de pregătire.



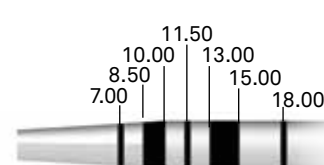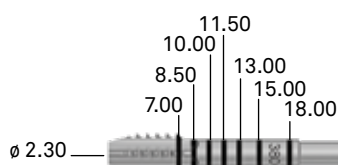Adâncimea de lucru este identificată și pe tarozi și osteotoame prin creștături laserate, după cum urmează:




Soluții protetice de excelență

ABUTMENT PLAIN B-SPACE CONVERGENTE PENTRU SOLUȚII ÎNȘURUBATE MULTIPLE

Un studiu revoluționar cu tomografie la sincrotronă a demonstrat că sinergia dintre suprafață și morfologia convergentă, comparativ cu morfologii divergente și suprafețe non-UTM, îmbunătățește aderența și activarea precoce a fibroblastelor, favorizând formarea unui sigiliu biologic și promovând integrarea țesuturilor moi periimplantare.

Fibrele conjunctive sunt mai interconectate, dense și stabile.

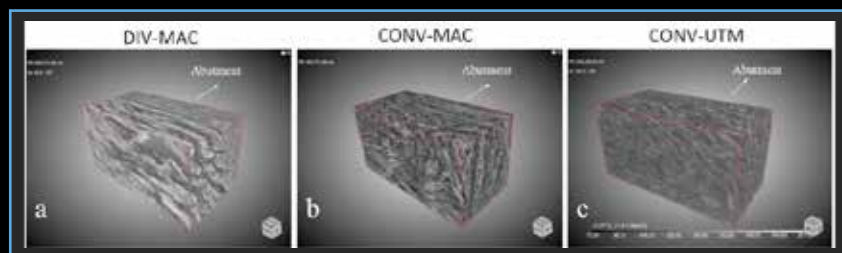Prezintă suprafața UTM pe tot profilul lor



Imagine oferită prin amabilitatea dr. L. Canullo, A. Giuliani, M. Furlani, M. Menini, A. Piattelli, G. Iezzi.



SISTEMATICĂ CONICĂ



Proteze fixe fără șuruburi și fără ciment

Ușor de îndepărtat și reinsertat de către clinician în câteva secunde

Sigiliu biologic și menținerea țesuturilor sănătoase și stabile în timp

Atât pentru coroane unice, cât și multiple


Nu poate fi îndepărtat de către pacient

PROTEZE XA

Caracteristica morfologiei convergente la capăt care oferă mai mult spațiu țesuturilor moi și susține vârfurile osoase.

Sunt proiectate pentru tehnica One-Abutment-One-Time și soluții de platform switching.

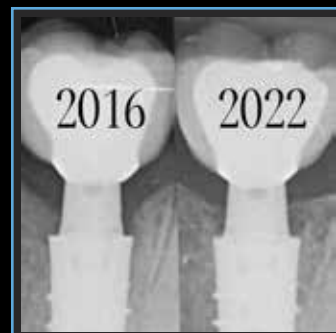La baza pilonilor pentru soluțiile cimentate și a abutmenturilor pentru soluții înșurubate există caracteristici microrills care permit stabilizarea țesutului conjunctiv



Imagine oferită prin amabilitatea dr. Xavier Vela

SOLUȚII PENTRU ORIFICIU ȘURUB ÎNCLINAT

Sunt soluții protetice versatile care rezolvă problemele de înclinare repositionând orificiul șurubului palatinal pentru a păstra estetica.

BONT CU ORIFICIU DE ȘURUB ORIENTABIL



Canula calcinabilă se rotește pe capul sferic al bontului permițând 360° de libertate de înclinare. Canula se rotește pe capul sferic al bontului permițând o corectare a unghiului de 28° în toate direcțiile



Aceste interfețe sunt o soluție ideală pentru fluxurile de lucru digitale.



Șurubelnița cu design hexalobat special permite prinderea capului șurubului chiar și în prezența unei înclinări accentuate și a unui orificiu de șurub repositionat palatinal

INTERFAȚĂ PENTRU ORIFICIU ȘURUB ÎNCLINAT

PAD^e PROTEZĂ ȘURUBATĂ DISPARALELĂ ESTETICĂ



Bonturi ușor de inserat

Libertate maximă și ergonomie a suprastructurilor

Anodizare roz pentru o mai bună mimetizare

Dimensiunea redusă le face potrivite pentru reabilitări ale arcadei parțial sau total edentate în spații orizontale și verticale restrânse

Sunt disponibile canule specifice pentru lipire cu orificiu standard sau orificiu înclinat pentru repositionarea palatinală a accesului șuruburilor.

Platforme implantare și combinații protetice

Platformele de conectare ale implanturilor Premium Power și Shelta Power sunt caracterizate de prezența unui hexagon intern și a unui guler extern identic pentru toate diametrele, ceea ce permite alegerea dimensiunii dorite a pilonului.

Conform protocolului protetic ales, este posibil să se realizeze un Platform Switching protetic cu un pilon de diametru mai mic sau să se utilizeze un pilon cu diametru congruent cu implantul.

ø implant	3.30 ●	3.80 ●	4.25 ●	5.00 ●
ø componentă protetică compatibilă	3.30 ●	3.30* ●	3.30* ●	3.30* ●
	-	3.80 ●	3.80 ●	3.80 ●
	-	-	4.25 ●	4.25 ●
	-	-	-	5.00 ●



Premium Power ø 5.00 mm cu pilon ø 3.80 mm



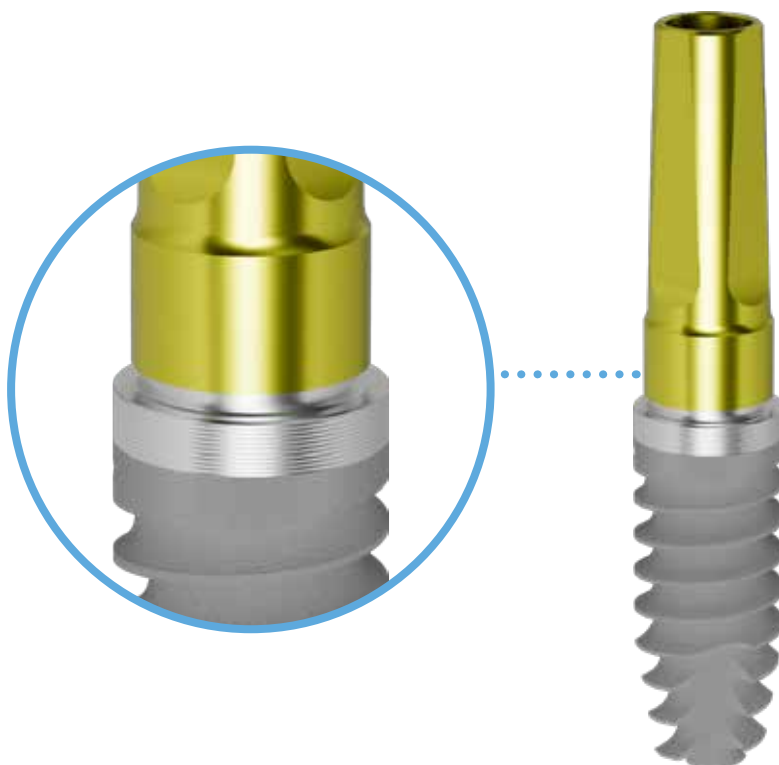
Premium Power ø 5.00 mm cu pilon ø 4.25 mm















Premium Power ø 5.00 mm cu pilon ø 5.00 mm

Notă bene





*Componentele protetice de ø 3.30 mm determină Platform Switching cu implanturi de ø 3.80, 4.25 și 5.00 mm, închizându-se pe guler și nu pe platformă (vezi imaginea alăturată). Se recomandă utilizarea acestor piloni pentru coroane unice exclusiv în sectoarele frontale (cu excepția premolarilor) și în sectoarele distale pentru susținerea protezelor multiple.









Cape de vindecare

Cu emergență dreaptă				
h mm	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
2.00	 A-TMG-330-2	 A-TMG-380-2		
3.00	 A-TMG-330-3	 A-TMG-380-3		
5.00	 A-TMG-330-5	 A-TMG-380-5		
7.00	 A-TMG-330-7	-		
Cu emergență anatomică				
h mm	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
2.00	 A-TMGR-330-2	 A-TMGR-380-2	 AS-TMGR-425-2	 AS-TMGR-500-2
3.00	 A-TMGR-330-3	 A-TMGR-380-3	 AS-TMGR-425-3	 AS-TMGR-500-3
5.00	 A-TMGR-330-5	 A-TMGR-380-5	 AS-TMGR-425-5	 AS-TMGR-500-5
7.00	-	 A-TMGR-380-7	 AS-TMGR-425-7	 AS-TMGR-500-7

Cu lărgire coronală



h mm	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●
2.00		
	A-TMTCR-330-2	A-TMTCR-380-2
3.00		
	A-TMTCR-330-3	A-TMTCR-380-3
5.00		
	A-TMTCR-330-5	A-TMTCR-380-5

Cu profil larg

h mm	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●
2.00		
	A-TMGB-330-2	A-TMGB-380-2
3.00		
	A-TMGB-330-3	A-TMGB-380-3
5.00		
	A-TMGB-330-4	A-TMGB-380-4


Tehnica REGISTRA

Șuruburi transfer

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●
Șurub transfer anatomic pentru Tehnica REGISTRA h 5,00 mm			
	A-TO-330-5	A-TO-380-5	AS-TO-425-5
Șurub transfer anatomic pentru Tehnica REGISTRA h 7,00 mm			
	A-TO-330-7	A-TO-380-7	AS-TO-425-7
Șurub transfer anatomic pentru Tehnica REGISTRA h 9,00 mm			
	A-TO-330-9	A-TO-380-9	AS-TO-425-9

Capac de transfer

Căpăcel universal pentru șuruburi de transfer REGISTRA









Urmărește cursul video gratuit despre Tehnica REGISTRA






Fază de amprentare și model

Transfer Pick-up






	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
emergență dreaptă	 12.00 ø 3.30 A-TRA-330	 12.00 ø 3.80 A-TRA-380	 12.00 ø 4.25 AS-TRA-425	 12.00 ø 5.00 AS-TRA-500
emergență anatomică	 12.00 ø 3.80 ø 3.30 A-TRAR-330	 12.00 ø 4.25 ø 3.80 A-TRAR-380	 12.00 ø 5.20 ø 4.25 AS-TRAR-425	 12.00 ø 6.00 ø 5.00 AS-TRAR-500

Șurub VTRA2-180-15 inclus.

Transfer Pull-up

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
emergență dreaptă	 11.50 ø 3.30 A-TRAP-330	-	-	-
emergență anatomică	 11.50 ø 3.80 ø 3.30 A-TRARP-330	 11.50 ø 4.60 ø 3.30 A-TRARP-380	 11.50 ø 5.00 ø 3.30 AS-TRARP-425	 11.50 ø 6.00 ø 3.30 AS-TRARP-500

Transfer prin detașare


	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
emergență dreaptă	 11.00 ø 3.30 A-TRAS-330	-	-	-
emergență anatomică	 11.00 ø 3.80 ø 3.30 A-TRAS-330	 11.00 ø 4.25 ø 3.80 A-TRAS-380	 11.00 ø 5.20 ø 4.25 AS-TRAS-425	 11.00 ø 6.00 ø 5.00 AS-TRAS-500

Șurub VTRA2-180-10 inclus.




Analogi

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
	 12.00 ø 3.30 A-ANA-330	 12.00 ø 3.80 A-ANA-380	 12.00 ø 4.25 SH-ANA-425	 12.00 ø 5.00 SH-ANA-500

Piloni provizorii

SIMPLE din PEEK cu bază din titan					
	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00	
	A-MPSC-330	-	-	-	repoziționabile, urgență dreaptă
	A-MPSCR-330	A-MPSCR-380	AS-MPSCR-425	AS-MPSCR-500	repoziționabile, urgență anatomică

Șurub VM2-180 inclus.

SIMPLE din titan					
	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00	
	A-MPSA-330-EX	A-MPSA-380-EX	-	-	repoziționabile, urgență anatomică
	A-MPSA-330	A-MPSA-380	-	-	nerepoziționabili, urgență anatomică
	A-MPSCI-330-EX	A-MPSCI-380-EX	AS-MPSCI-425-EX	AS-MPSCI-500-EX	repoziționabile, urgență dreaptă
	A-MPSCI-330	A-MPSCI-380	AS-MPSCI-425	AS-MPSCI-500	nerepoziționabili, urgență anatomică
	A-MPS-330	A-MPS-380	-	-	nerepoziționabili, urgență largă

Șurub VM2-180 inclus.

Din titan cu canulă calcinabilă					
	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00	
	A-CTI-330	A-CTI-380	-	-	nerepoziționabile
	A-CCI-S	A-CCI-S	-	-	canulă calcinabilă de schimb, șurub neinclus





Șurub VM2-180 inclus.

Canule netede pentru lipire		
	platformă unică	
	L-CT-340-ROT	canulă netedă din Ti Gr.5, h 14.00 mm, urgență dreaptă
	L-CCRCO-340-ROT	canulă netedă din crom-cobalt, h 14.00 mm, urgență dreaptă
	L-CTR-340-ROT	canulă netedă din Ti Gr.5, h 14.00 mm, urgență anatomică
	L-CCR COR-340-ROT	canulă netedă din crom-cobalt, h 14.00 mm, urgență anatomică

Șurub L-VMS-180 inclus.


Piloni preformați

Drepti

emergență dreaptă	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
transmucozal h 1,00	 A-MD-330-1	 A-MD-380-1	 AS-MD-425-1	 AS-MD-500-1
transmucozal h 2.00	 A-MD-330-2	 A-MD-380-2	 AS-MD-425-2	 AS-MD-500-2
transmucozal 4,00 h	 A-MD-330-4	 A-MD-380-4	 AS-MD-425-4	 AS-MD-500-4
emergență anatomică				
transmucozal h 1,00	 A-MDR-330-1	 A-MDR-380-1	 AS-MDR-425-1	 AS-MDR-500-1
transmucozal h 2.00	 A-MDR-330-2	 A-MDR-380-2	 AS-MDR-425-2	 AS-MDR-500-2
transmucozal 4,00 h	 A-MDR-330-4	 A-MDR-380-4	 AS-MDR-425-4	 AS-MDR-500-4

Șurub VM2-180 inclus.

Angulate

	ø 3.30	ø 3.80	ø 4.25	ø 5.00
angulat la 15°, emergență dreaptă transmucozal h 1,75	 A-MA15-330	-	-	-
angulat la 15°, emergență anatomică transmucozal h 1,80	 A-MAR15-330	 A-MAR15-380	 AS-MAR15-425	 AS-MAR15-500
angulat la 25°, emergență anatomică transmucozal h 1,80	-	 A-MAR25-380	 AS-MAR25-425	-

Șurub VM2-180 inclus.



Piloni preformați drepți gata de montare

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
repoziționabili h 15	 A-MD-330-15	 A-MD-380-15	-	-
nerepoziționabile h 15	 A-MD-330-15-ROT	 A-MD-380-15-ROT	-	-

Șurub L-VMS-180 inclus.






Piloni și componente pentru tehnica verticală

Pentru tehnica verticală






	platformă unică
transmucose din titan Gr. 5	 A-TMG-MEFL-330
piloni din rășină REEF, repoziționabili	 A-PPF-330-EX
piloni din rășină REEF, nerepoziționabile	 A-PPF-330
piloni frezabili din titan Gr. 5	 A-MEFL-330
capace de amprentă pachet de 5 bucăți	 CAP-MEFL-5

Piloni din rășină și frezabili: șurub VM2-180 inclus.





Piloni frezabili

Drepti				
	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
emergență dreaptă				
	A-MF-330	A-MF-380	AS-MF-425	AS-MF-500
emergență anatomică				
	A-MFR-330	A-MFR-380	AS-MFR-425	AS-MFR-500

Șurub VM2-180 inclus.

Pre-descărcat				
	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
emergență dreaptă		-	-	-
	A-MFP-330	-	-	-
emergență anatomică				
	A-MFPR-330	A-MFPR-380	AS-MFPR-425	AS-MFPR-500




Șurub VM2-180 inclus.

SIMPLE				
	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
emergență foarte largă				
	A-MFS-330	A-MFS-380	AS-MFS-425	AS-MFS-500

Șurub VM2-180 inclus.








Linie protetică XA - Proteză cimentată

Piloni XA pentru protocoale cimentate

h transmucozală	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
1.00 mm	 SH-MD-F-330-1	 SH-MD-F-380-1	 SH-MD-F-425-1	-
2.00 mm	 SH-MD-F-330-2	 SH-MD-F-380-2	 SH-MD-F-425-2	-


Șurub L-VMS-180 inclus.

Componente XA pentru protocoale cimentate

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
analogi	 SH-ANA-MD-F-330	 SH-ANA-MD-F-380	 SH-ANA-MD-F-425	-
transfer	 SH-TRA-MD-F-330	 SH-TRA-MD-F-380	 SH-TRA-MD-F-425	-
capace din PEEK	 SH-CP-MD-F-330	 SH-CP-MD-F-380	 SH-CP-MD-F-425	-

Linie protetică XA - Proteză înșurubată

Piloni XA pentru protocoale înșurubate


h	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●
4.50 mm	 4.70 A-ABU-F-TS-330-4	 4.70 SH-ABU-F-TS-380-4
5.50 mm	 5.50 A-ABU-F-TS-330-5	 5.50 SH-ABU-F-TS-380-5
6.50 mm	 6.50 A-ABU-F-TS-330-6	 6.50 SH-ABU-F-TS-380-6

Piloni h 4,50 mm: șurub SH-VABU180-200-4 inclus.

Piloni h 5,50 mm: șurub SH-VABU180-200-5 inclus.

Piloni h 6,50 mm: șurub SH-VABU180-200-6 inclus.




Componente XA pentru proteză digitală

	platformă unică
Scanbody pentru laborator și pentru utilizare intraorală din titan pentru piloni XA	 10.00 XA-INT-CAMTRA-L
Analog digital pentru abutment XA	 4.00 XA-ANABU-DIG
Premilled din titan pentru abutment XA XA-CAMT-ABU-12-SW	 20.00 XA-CAMT-ABU-12-SW
Premilled din crom-cobalt pentru abutment XA XA-CAMT-ABU-12-SW	 20.00 XA-CAMT-ABU-12-SW
T-Connect pentru proteză multiplă abutment XA, prof. 1.0	 5.30 XA-TCIN-10-ROT
T-Connect pentru proteză multiplă abutment XA	 5.30 XA-TCIN-ROT
T-Connect pentru proteză unică abutment XA	 5.30 XA-TCIN

Scanbody și premilled: șurub A-PLAIN-VP200 inclus.

Analog: șurub VADIG-180 inclus.

Componente de laborator și pentru suprastructuri XA pentru protocoale înșurubate



	platformă unică
analogi	 4.00 SH-ANABU-F-380
transfer	 8.50 SH-TRABU-F-380
canule calcinabile, repoziționabile	 10.00 SH-CCABU-F-380
canule calcinabile, nerepoziționabile	 10.00 SH-CCABU-F-380-ROT
capă de vindecare din PEEK	 4.00 SH-CG-ABU-F-380
canule din titan Gr. 5, repoziționabile	 10.00 SH-CTABU-F-380
canule din titan Gr. 5, nerepoziționabile	 10.00 SH-CTABU-F-380-ROT
capace pentru lipire	 5.30 CAP-TS-DEF

Transfer: șurub SH-VTRABU-F-200 inclus.

Canule calcinabile și din titan: șurub A-PLAIN-VP200 inclus.






Piloni calcinabili

Cu bază metalică

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
bază din crom-cobalt, repoziționabili	 A-UCRCO-330-EX	 A-UCRCO-380-EX	 AS-UCRCO-425-EX	 AS-UCRCO-500-EX
bază din crom-cobalt, nerepoziționabile	 A-UCRCO-330	 A-UCRCO-380	 AS-UCRCO-425	 AS-UCRCO-500
bază din titan, nerepoziționabile <i>doar pentru prelucrări din titan</i>	 A-UCTR-330-EX	 A-UCTR-380-EX	-	-
canulă calcinabilă de schimb, șurub neinclus	 A-CCUCR-330	 A-CCUCR-380	 AS-CCUCR-425	 AS-CCUCR-500

Șurub VM2-180 inclus.


Complet calcinabile

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
repoziționabile, emergență dreaptă	 A-CC-330-EX	 A-CC-380-EX	-	-
repoziționabile, emergență anatomică	 A-CCR-330-EX	 A-CCR-380-EX	 AS-CCR-425-EX	 AS-CCR-500-EX
nerepoziționabili, emergență dreaptă	 A-CC-330	 A-CC-380	-	-
nerepoziționabili, emergență anatomică	 A-CCR-330	 A-CCR-380	 AS-CCR-425	 AS-CCR-500

Șurub VM2-180 inclus.

Soluții cu orificiu pentru șurub înclinat

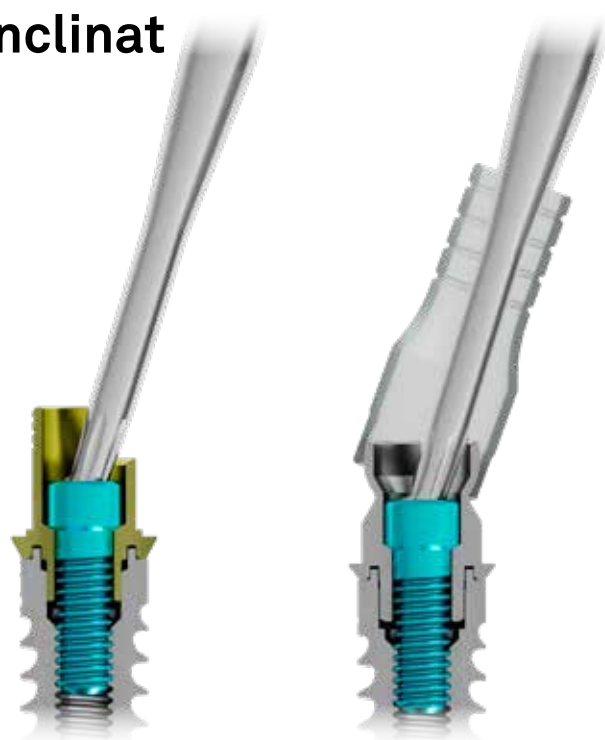Aceste suporturi prezintă o morfologie particulară, cu o fereastră laterală sau cu un element orientabil, care permite deplasarea orificiului pentru șurubul de trecere în poziție palatinală sau linguală, evitând astfel orificiile vestibulare inestetice.



Interfețe pentru orificiu înclinat

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
nerepoziționabile	 IND3PKR330/TIA	 IND3PKR380/TIA	-	-
repoziționabili	 IND3PKH330/TIA	 IND3PKH380/TIA	-	-

Șurubul A-VMA-180 nu este inclus.









Abutment pentru orificiu înclinat

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
bază din crom-cobalt, repoziționabili	 PD3PKH330/CC	 PD3PKH380/CC	-	-
bază crom cobalt, nerepoziționabili	 PD3PKR330/CC	 PD3PKR380/CC	-	-
complet calcinabile, relocabile	 PD3PKH330/P	 PD3PKH380/P	-	-
complet calcinabile, care nu pot fi repoziționate	 PD3PKR330/P	 PD3PKR380/P	-	-

Șurubul A-VMA-180 nu este inclus.





Linie protetică PAD^{si} (Proteze Înșurubate Disparalele Estetice)

Drepte cu înșurubare directă

h. transmucozal	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
1.50 mm	 A-PADE-AD330-15	 A-PADE-AD380-15	 AS-PADE-AD425-15	 AS-PADE-AD500-15
3.00 mm	 A-PADE-AD330-30	 A-PADE-AD380-30	 AS-PADE-AD425-30	 AS-PADE-AD500-30
4.00 mm	 A-PADE-AD330-40	 A-PADE-AD380-40	 AS-PADE-AD425-40	 AS-PADE-AD500-40

Ambalat cu carrier dedicat: pentru înșurubarea intraorală utilizați șurubelnița specială AVV2-ABUT.

Angulate

h. transmucozal	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
Angulate la 17° h transmucozală 3.00	 A-PADE-AA330-173	 A-PADE-AA380-173	 AS-PADE-AA425-173	 AS-PADE-AA500-173
Angulate la 17° h transmucozală 5.00	 A-PADE-AA330-175	 A-PADE-AA380-175	 AS-PADE-AA425-175	 AS-PADE-AA500-175
Angulate la 30° h transmucozală 3.00	 A-PADE-AA330-303	 A-PADE-AA380-303	 AS-PADE-AA425-303	 AS-PADE-AA500-303
Angulate la 30° h transmucozală 5.00	 A-PADE-AA330-305	 A-PADE-AA380-305	 AS-PADE-AA425-305	 AS-PADE-AA500-305
Angulate la 45° h transmucozală 3.00	 A-PADE-AA330-453	 A-PADE-AA380-453	-	-
Angulate la 45° h transmucozală 5.00	 A-PADE-AA330-455	 A-PADE-AA380-455	-	-

Șurub PADR-VM-180 inclus

Carrier PADR-VTRAL-140-M inclus: pentru înșurubarea intraorală utilizați șurubelnița specială din seria HSM.

Componente pentru suprastructuri

Cape de vindecare

Capă de vindecare din titan



PADR-CG

Capă de vindecare din PEEK



PADR-CGP

PADR-CG: șurub PAD-VP-140 inclus.

PADR-CGP: șurub PAD-VCGP-140 inclus.

Componente pentru proteze digitale

Scanbody intraoral



PADR-INT-CAMTRA-L

Scanbody intraoral pentru înșurubare directă*



Y-AVV-SB-DIG-NX

Scanbody intraoral pentru înșurubare directă lungă*



Y-AVV-SBL-DIG-NX

Analog digital pentru abutment PADe



PADR-ANA-DIG

Cannulă pentru lipire rotativă pentru abutment PADe cu con h. 4



PADR-TC-M-4

Cannulă pentru lipire rotativă pentru abutment PADe cu con h 8 cu creștături de reducere



PADR-TC-M-8

Cannulă pentru lipire rotativă pentru abutment PADe pentru orificiu înclinat



PADR-TCA-M

Sleeve calcinabil rotativ pentru PADR-TC-M-4 și PADR-TC-M-8



PADR-TC-CC-M-8

Sleeve calcinabil indexat pentru PADR-TCA-M



PADR-TC-CC-S-8

Scanbody și canule pentru lipire: șurub PAD-VP-140 inclus.

Cannulă pentru lipire rotativă pentru abutment PADe pentru orificiu înclinat:

șurub PAD-VPA-140 neinclus.

Analog digital: șurub VADIG-180 inclus.

**Șurubelniță YV-CV-MAN-M.*

Amprentare

Capac snap-on pentru amprentare



PADR-CAP-EX

Transfer pick-up, nerepoziționabil



PADR-TRA

Analog




PADR-ANA

Transfer Pick up: șurub PAD-VTRAL-140 inclus.

Componente pentru rebazare și tehnică pentru lipire

Cannulă din PEEK, neindexată



PADR-CP

Cannulă din titan, neindexată




PADR-CT

Cannulă calcinabilă din PMMA



PADR-CEM

Cannulă calcinabilă din PMMA, neindexată



PADR-CC

Cannulă din titan fără umăr, pentru reconstrucții estetice



PADR-BAS

Cannule din PEEK, Titan Gr. 5 și PMMA: șurub PAD-VP-140 inclus.

Pilon calcinabil cu bază metalică

Pilon din PMMA cu bază din crom-cobalt, nerepoziționabil



PADR-UCRCO

Șurub PAD-VP-140 inclus.

Linia protetică PLAIN B-Space

Abutment

h transmucozală	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
2.00 mm	 2.00 A-PLAIN-ABU330-2	 2.00 A-PLAIN-ABU-380C-2	 2.00 AS-PLAIN-ABU-425C-2	 2.00 AS-PLAIN-ABU-500C-2
3.00 mm	 3.00 A-PLAIN-ABU330-3	 3.00 A-PLAIN-ABU-380C-3	 3.00 AS-PLAIN-ABU-425C-3	 3.00 AS-PLAIN-ABU-500C-3
4.00 mm	 4.00 A-PLAIN-ABU330-4	 4.00 A-PLAIN-ABU-380C-4	 4.00 AS-PLAIN-ABU-425C-4	 4.00 AS-PLAIN-ABU-500C-4

Componente pentru suprastructuri pe abutment PLAIN

platformă unică	
cape de vindecare	 5.00 A-PLAIN-CG330
canule calcinabile	 10.00 A-PLAIN-CC330
canule din titan Gr. 5	 9.50 1.30 A-PLAIN-CT330
transfer Pick-up	 12.00 A-PLAIN-TRA-330
analogi	 12.00 A-PLAIN-ANA-330

Canule calcinabile și canule din titan: șurub A-PLAIN-VP200 inclus.
Transfer Pick-up: șurub A-PLAIN-VTRA200 inclus.

Componente PLAIN B-Space pentru proteză digitală

platformă unică	
Scanbody pentru laborator și pentru utilizare intraorală din titan pentru abutment PLAIN	 13.00 A-INT-CAMTRA-PLAIN-L
Analog digital pentru abutment B-Space	 12.00 A-PLAIN-ANA-330-DIG
Canulă pentru lipire PLAIN B-Space h 6.00 mm	 5.50 A-PLAIN-MDT-6
Canulă pentru lipire PLAIN B-Space h 10.00 mm	 10.00 A-PLAIN-MDT-10

Scanbody: șurub A-PLAIN-VP200 inclus.
Analog digital: șurub VADIG-180 inclus.
Canule pentru lipire PLAIN B-Space: șurub neinclus.
Se poate comanda separat șurub pentru orificiu drept A-PLAIN-VP200 sau șurub pentru orificiu înclinat ABU-VMA-200.




Proteze conometrice Conico

Piloni Conici drepti

h	ø 3.30	ø 3.80
0.50		-
	A-MD-TS-330-05	
1.00		
	A-MD-TS-330-10	A-MD-TS-380-10
2.00		
	A-MD-TS-330-20	A-MD-TS-380-20
3.00		
	A-MD-TS-330-30	A-MD-TS-380-30




Șurub VM2-180 inclus.

Piloni Conici angulați

	ø 3.30	ø 3.80
încălate la 7,5°		
	A-MA07-TS-330-2	A-MA07-TS-380-2
încălate la 15°		
	A-MA15-TS-330-2	A-MA15-TS-380-2
încălate la 22,5°		
	A-MA20-TS-330-2	A-MA20-TS-380-2

Șurub VM2-180 inclus.

Componente Conico pentru proteză digitală


capă pentru proteză fixă parțială sau full-arch	
	CAP2-TS-DEF
capă antirotativă pentru element unic	
	CAP2-TS-IND
capă pentru îndepărtare	
	CAP2-TS-REM
capă transfer din PEEK pentru amprentă pe bont Conico	
	CAP2-TS-IMP
analog pilon Conico	
	ANA2-MD-TS
capă cu pin de utilizat pentru sudură intraorală	
(bare pentru sudură disponibile la cerere)	CAP2-TS-PIN

Accesorii pentru sistemul Conico

paralelometru	
	PAR-PP
insertie pentru paralelometru	
	PAR-INS-AS
șurubelniță pentru paralelometru	
	CAP2-TS-PAR

Vă rugăm să achiziționați întotdeauna paralelometrul împreună cu insertia corespunzătoare conexiunii implantare pe care urmează să fie utilizat.

Componente Conico pentru proteză digitală

platformă unică	
	C-INT-CAMTRA-L
Scanbody pentru laborator și pentru utilizare intraorală din titan pentru sistemul Conico	
	ANA2-MD-TS-DIG

Analog digital: șurub VADIG-180 inclus.

Componente pentru proteze digitale

Scanbody pentru laborator și pentru utilizare intraorală din titan


ø 3.30

ø 3.80

pentru a transfera
poziția conexiunilor
implantare



A-INT-CAMTRA330-L



A-INT-CAMTRA380-L

Șurub VM2-180 inclus.

Analogi digitali

ø 3.30


ø 3.80

ø 4.25

ø 5.00



A-ANA-330-DIG



A-ANA-380-DIG



SH-ANA-425-DIG



SH-ANA-500-DIG

Șurub VADIG-180 inclus.

Componente pentru tehnici speciale

pentru bont P.A.D.r


pentru bont PLAIN B-Space

pentru piloni XA


pentru sistematică Conico




PADR-INT-CAMTRA-L



A-INT-CAMTRA-PLAIN-L



XA-INT-CAMTRA-L



C-INT-CAMTRA-L



PADR-ANA-DIG



A-PLAIN-ANA-330-DIG



XA-ANABU-DIG



ANA2-MD-TS-DIG

Scanbody pentru bont PLAIN și scanbody piloni XA: șurub A-PLAIN-VP200 inclus.

Scanbody pentru bont P.A.D.r: șurub PAD-VP-140 inclus.

Analogi digitali: șurub VADIG-180 inclus.

Șuruburi și șurubelnițe pentru analogi digitali

platformă unică

Șurub pentru
analog digital
M 1.8



VADIG-180

Pin pentru
analog digital



PIN-ANA-DIG

Carrier pentru
inserarea
analogului
digital M 1.8















INS-ANA-180

Carrier pentru
inserarea
analogului
digital M 1.8,
lung



INS-ANA-180-L

T-Connect cu con de cimentare de h 4,00 mm



	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
				
	A-BASTZR-S-330-4	A-BASTZR-S-380-4	AS-BASTZR-S-425-4	AS-BASTZR-S-500-4
repoziționabili			-	-
	A-TCR-S-330-4-1	A-TCR-S-380-4-1		
			-	-
	A-TCR-S-330-4-2	A-TCR-S-380-4-2		
			-	-
	A-TCR-S-330-4-3	A-TCR-S-380-4-3		
nerepoziționabili				
	A-BASTZR-M-330-4	A-BASTZR-M-380-4	AS-BASTZR-M-425-4	AS-BASTZR-M-500-4
			-	-
	A-TCR-M-330-4-1	A-TCR-M-380-4-1		
			-	-
	A-TCR-M-330-4-2	A-TCR-M-380-4-2		
			-	-
	A-TCR-M-330-4-3	A-TCR-M-380-4-3		

Șurub VM2-180 inclus.

Canule pentru modelarea wax-up pe T-Connect

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
h total 12,00 mm				
	A-CCBAS-330-4	A-CCBAS-380-4	A-CCBAS-425-4	A-CCBAS-500-4

Interfață pentru orificiu șurub înclinat

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●
nerepoziționabili		
	IND3PKR330/TIA	IND3PKR380/TIA
repoziționabili		
	IND3PKH330/TIA	IND3PKH380/TIA

Șurubul A-VMA-180 nu este inclus.

Surub VM2-180 inclus.

Canule pentru modelarea wax-up pe T-Connect

h total 12,00 mm

T-Connect Unică

ø 3.30 ●

ø 3.80 ●

ø 4.25 ●


ø 5.00 ●




A-TC-UNI-330



A-TC-UNI-380




AS-TC-UNI-425



AS-TC-UNI-500


repoziționabil




A-TC-UNI-330-1




A-TC-UNI-380-1




AS-TC-UNI-425-1




AS-TC-UNI-500-1



A-TC-UNI-330-2




A-TC-UNI-380-2




AS-TC-UNI-425-2




AS-TC-UNI-500-2




A-TC-UNI-330-3



A-TC-UNI-380-3



AS-TC-UNI-425-3



AS-TC-UNI-500-3



A-TC-UNI-330-ROT



A-TC-UNI-380-ROT



AS-TC-UNI-425-ROT



AS-TC-UNI-500-ROT

nerepoziționabil



A-TC-UNI-330-1-ROT




A-TC-UNI-380-1-ROT



AS-TC-UNI-425-1-ROT



AS-TC-UNI-500-1-ROT



A-TC-UNI-330-2-ROT




A-TC-UNI-380-2-ROT




AS-TC-UNI-425-2-ROT




AS-TC-UNI-500-2-ROT



A-TC-UNI-330-3-ROT



A-TC-UNI-380-3-ROT



AS-TC-UNI-425-3-ROT



AS-TC-UNI-500-3-ROT

Șurub VM2-180 inclus.

În cazul deschiderii ferestrei pentru orificiul șurubului înclinat, șurubul corespunzător A-VMA-180 trebuie comandat separat, de utilizat cu șurubelnița specială DSPDCLH-24 sau DSPDCLH-32.

Șabloane de tăiere și suporturi pentru T-Connect Unica



Suport S (mic) pentru șablon de tăiere pentru T-Connect Unica, partea stângă

TC-UNI-HOLD4-SX

Suport S (mic) pentru șablon de tăiere pentru T-Connect Unica, partea dreaptă

TC-UNI-HOLD4-DX


Suport L (mare) pentru șablon de tăiere pentru T-Connect Unica, partea dreaptă

TC-UNI-HOLD6-DX

Suport L (mare) pentru șablon de tăiere pentru T-Connect Unica, partea stângă


TC-UNI-HOLD6-SX

șablon de tăiere de 4 mm pentru T-Connect Unica



TC-UNI-DIMA-H4

șablon de tăiere de 6 mm pentru T-Connect Unica



TC-UNI-DIMA-H6

șablon de tăiere pentru orificiu înclinat pentru T-Connect Unica



TC-UNI-DIMA-ANG

Notă: este disponibil fișierul stl pentru a imprima independent suporturile.



Vezi cât de ușor este să personalizezi cu precizie T-Connect Unica cu șabloanele de tăiere și suportul dedicat

Accesorii pentru T-Connect Unica

O-ring pentru teste intraorale pentru T-Connect Unica



TC-UNI-ORING

Canulă calcinabilă pentru T-Connect Unica, nerepoziționabilă



TC-UNI-CC

Canulă calcinabilă mică pentru T-Connect Unica, repoziționabilă



TC-UNI-CC-S

Canulă calcinabilă mare pentru T-Connect Unica, repoziționabilă



TC-UNI-CC-L

Inserator O-Ring



C-UNI-ORING-INS

T-Connect pentru XA

T-Connect pentru proteză multiplă abutment XA, prof. 1.0



XA-TCIN-10-ROT

T-Connect pentru proteză multiplă abutment XA



XA-TCIN-ROT

T-Connect pentru proteză unică abutment XA



XA-TCIN

Componente pentru proteze digitale chairside

T-Connect chairside cu con de cimentare de h 5,00 mm

h transmucos	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
				
	A-TCS-330S-C	A-TCS-380S-C	AS-TCS-425L-C	AS-TCS-500L-C
1.50 mm			-	-
	A-TCS-330S-C-15	A-TCS-380S-C-15		
2.50 mm			-	-
	A-TCS-330S-C-25	A-TCS-380S-C-25		

Șurub VM2-180 inclus.

Premilled

Din titan pentru implanturi

	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●	ø 5.00 ●
repoziționabili				
din titan	A-CAMT-330-12-SW	A-CAMT-380-12-SW	AS-CAMT-425-12-SW	AS-CAMT-500-12-SW
din crom-cobalt	-	A-CAMC-380-12-SW	AS-CAMC-425-12-SW	AS-CAMC-500-12-SW

Șurub VM2-180 inclus.

Nivel platformă

platformă unică		
repoziționabili		
	din titan	A-CAMTABU330-CRE

Șurub VM2-180 inclus.

Din titan pentru bont XA

	platformă unică
repoziționabili	
din titan	XA-CAMT-ABU-12-SW
din crom-cobalt	XA-CAMC-ABU-12-SW

Șurub A-PLAIN-VP200 inclus.

Soluzioni per overdenture

Bont Locator

h transmucoasă	ø 3.30	ø 3.80
1.00 mm	 1670	 1675
2.00 mm	 1671	 1676
3.00 mm	 1672	 1677
4.00 mm	-	 1678
5.00 mm	 1674	 1679
6.00 mm	-	 1680

Accesorii pentru bontul Locator

	platformă unică
4 analogi din aluminiu	 8530
4 transferuri din aluminiu, 4 dispozitive de fixare cod. 8515 inclus	 8505
4 pini de paralelism din polietilenă	 8517
plăci din oțel AISI 316 L	 9530
Locator Core Tool complet	 8393
vârf din oțel pentru inserarea retainerilor	 8397
drive din oțel pentru înșurubarea / deșurubarea abutmentului	 8390
manșoane de retenție pentru driveri, pentru transportul abutmentelor în cavitatea bucală	 8394

Garnituri și dispozitive de fixare pentru bont Locator

	platformă unică
retenție redusă pentru luarea ampretei, polietilenă, negru pachet de 4 unități	 8515
retenție 5 lb = 2268 g, nailon, disparelelism până la 10° pe fiecare parte , pachet de 4 unități	 8524
retenție 3 lb = 1361 g, nailon, disparelelism până la 10° pe parte , pachet de 4 unități	 8527
retenție 1,5 lb = 680 g, în nailon, disparelelism de până la 10° pe fiecare parte, pachet de 4 unități	 8529
retenție 4 lb = 1814 g, în nailon, disparelelism de până la 20° pe fiecare parte, pachet de 4 unități	 8547
retenție 2 lb = 907 g, în nailon, disparelelism de până la 20° pe fiecare parte, pachet de 4 unități	 8915
retenție 1 lb = 450 g, în nailon, disparelelism de până la 20° pe fiecare parte, pachet de 4 unități	 8548
Inele distanțiere de schimb din cauciuc siliconic, pachet de 20	 8514
kit cu 2 capace din titan Gr. 5, 2 inele distanțiere, 2 suporturi negri, 2 suporturi pentru fiecare dintre cele 3 capacități de retenție diferite	 8519-2
kit cu 2 capace din titan Gr. 5, 2 inele distanțiere, 2 elemente de fixare negre, 2 elemente de fixare pentru fiecare dintre cele 3 capacități diferite de fixare pentru disparelelisme mari	 8540-2
kit cu 2 capace din oțel, 2 inele distanțiere, 2 suporturi negri, 2 suporturi pentru fiecare dintre cele 3 capacități de retenție diferite	 8550-2

Șurubelnițe Locator pentru pilon protetic

	platformă unică
scurt	 8926-SW
lung	 8927-SW

Bont Locator R-Tx*

h transmucoasă	ø 3.30 ●	ø 3.80 ●
1.00 mm	 1.00 31110-01	 1.00 31111-01
2.00 mm	 2.00 31110-02	 2.00 31111-02
3.00 mm	 3.00 31110-03	 3.00 31111-03
4.00 mm	 4.00 31110-04	 4.00 31111-04
platformă unică	 5.00 31110-05	 5.00 31111-05
6.00 mm	 6.00 31110-06	 6.00 31111-06

* Ambalaj multifuncțional, care include un bont, un inel distanțier, o garnitura și un insert pentru fiecare retenție (gri, albastru, roz, alb).

Garnituri și dispozitive de fixare pentru bonturi Locator R-Tx

	platformă unică
conf. din nr. 4 garnituri negre și 4 dispozitive de contenție negre pentru luarea amprente	 30013
pachet de nr. 4 inserții gri , fără retenție	 30001
pachet de nr. 4 inserții albastre , cu retenție redusă	 30002
pachet de nr. 4 inserții roz , retenție medie	 30003
pachet de 4 inserții albe , retenție ridicată	 30004
conf. din nr. 4 dispozitive de contenție din plastic negru pentru luarea amprente	 30012


Accesorii pentru bontul Locator R-Tx

	platformă unică
set de 4 analogi din aluminiu pentru Locator R-Tx ø 3.35 mm	 30014
set de 4 analogi din aluminiu pentru Locator R-Tx ø 4.00 mm	 30015
set de 4 analogi din aluminiu pentru Locator R-Tx ø 5.00 mm	 30016
set de nr. 4 transferuri pentru Locator R-Tx cu retenție scăzută, dimensiune unică	 30017
pachet de 4 garnituri distanțiere pentru realizarea sau retușarea protezelor	 30018
Locator core tool pentru Locator R-Tx	 30021
Șurubelniță contraunghi pentru Locator R-Tx, hex. 1.25 mm	 08008
șurubelniță digitală pentru Locator R-Tx, hex. 1.25 mm	 08007


Atasamente sferice

ø 3.30 ●


ø 3.80 ●




A-AS-330-1




A-AS-380-1




A-AS-330-2



A-AS-380-2



A-AS-330-4



A-AS-380-4

Analog pentru atașamente sferice

platformă unică



ANAS

Capace pentru atasamente sferice

platformă unică

capace din poliamidă



040CRNSNDR8-SM*

recipiente din oțel pentru
capac, diametru exterior ø 4,80
mm



041CAN-SM*

capace din titan Gr. 5, prevăzute
cu capac din două părți, arc
de fixare din titan și inel de
montare din plastic



CAP-TIT-1

inele din plastic de schimb



AN-CAP-TIT-1

arcuri de retenție de schimb
pentru căptușeli din titan,
duritate medie



MOL1-CAP-TIT-1

arcuri de retenție de schimb
pentru căptușeli din titan,
moale



MOL2-CAP-TIT-1

capace din aliaj de aur, complete
cu 3 inele din plastic și un
distanțier din staniu pentru
laborator



CAP-1

* Pachet de 6 bucăți.

Bară

bare calcinabile, l 5,00 cm,
h 3,00 mm, grosime 2,20 mm, profil
ovoidal cu distanțier



BARC-CAV-TIT

cavalieri divizibili din titan pentru
bare ovoidale, h 3,00 mm, grosime
2,20 mm



CAV-TIT

bare calcinabile, l 5,00 cm,
ø 2.20 mm



BARC

cavalieri din aliaj de aur pentru
bare rotunde de ø 2,20 mm



CAV-375

Șuruburi protetice clinice și de laborator

Șuruburi de strângere standard

	VM2-180	
	VM2-180-10	pachet de 10 unități

Șuruburi de strângere cu sprijin conic

	L-VMS-180	
	L-VMS-180-10	pachet de 10 unități

Șuruburi de strângere pentru orificiu de șurub înclinat

	A-VMA-180	
---	-----------	--

Șuruburi pentru transfer Pick-up

	VTRA2-180-15	h 15.00
	VTRA2-180-20	h 20.00
	VTRA2-180-MAN	pentru înșurubare manuală

Șuruburi de strângere pentru transfer cu extragere

	VTRA2-180-10	h 10.00
--	--------------	---------

Șuruburi pentru tehnica XA

	SH-VABU180-200-4	pentru pilon de h 4.50 pentru proteză înșurubată
	SH-VABU180-200-5	pentru pilon de h 5.50 pentru proteză înșurubată
	SH-VABU180-200-6	pentru pilon de h 6.50 pentru proteză înșurubată
	A-PLAIN-VP200	pentru proteză cimentată
	L-VMS-180	pentru proteză cimentată
	SH-VTRABU-F-200	șurub de transfer pentru bont XA

Cuplu recomandat pentru strângerea componentelor protetice

8-10 Ncm	șuruburi chirurgicale de închidere, transmucoase de vindecare, șuruburi pentru transfer
20-25 Ncm	toate șuruburile protetice
25-30 Ncm	toate componentele protetice cu înșurubare directă pe implant
8-10 Ncm	șuruburi de strângere transfer

Avertisment important

Șuruburile de strângere sunt întotdeauna incluse în ambalajele fiecărei componente protetice, cu excepția cazurilor în care este indicat în mod expres. Se recomandă utilizarea șuruburilor de probă pentru etapele de laborator și păstrarea noului șurub din set pentru fixarea definitivă în cavitatea bucală.

Șuruburi pentru bont PADe

	PADR-VM-180	pentru bont PADe
	PADR-VM-180-10	pentru bont PADe, pachet de 10 unități
	PAD-VTRAL-140	pentru transfer Pick-up, lungă
	PAD-VTRA-140	pentru transfer Pick-up, standard
	PAD-VTRAL-140-MAN	pentru transfer Pick-up, pentru înșurubare manuală
	PAD-VP-140	pentru componente protetice pe bont PADe
	PAD-VP-140-10	pentru componente protetice pe bont PADe, pachet de 10 unități
	PAD-VPA-140	șurub de strângere pentru PADR-TCA-M de utilizat cu șurubelnițele dedicate DSPDCLH-24 și DSPDCLH-32
	PADR-VTRAL-140-M	carrier pentru PADe

Șuruburi pentru bont PLAIN

	A-PLAIN-VP200	pentru bont PLAIN
	A-PLAIN-VP200-10	pentru bont PLAIN, pachet de 10 unități
	A-PLAIN-VTRA200	pentru transfer Pick-up pentru bont PLAIN
	ABU-VMA-200	șurub pentru orificiu înclinat

Șuruburi de strângere pentru proteze CAD-CAM


	A-CAMTVABU180	pentru strângerea bonturilor individuale sau a suprastructurilor ECHO din oxid de zirconiu
	PAD-VCAM140	pentru strângerea suprastructurilor din oxid de zirconiu pe bont PADe
	CAMPRON205-10	inele de amortizare a capului șurubului de strângere
	VADIG-180	șurub de blocare pentru analogii digitali

Secvențe de preparare a sitului implantar

Secvențe de preparare a sitului implantar pentru implanturile Premium Power

Secvența ilustrată mai sus reprezintă un exemplu de preparare pentru un implant Prama Power cu lungimea de 11,50 mm și diametrul $\varnothing$ 5,00 mm.

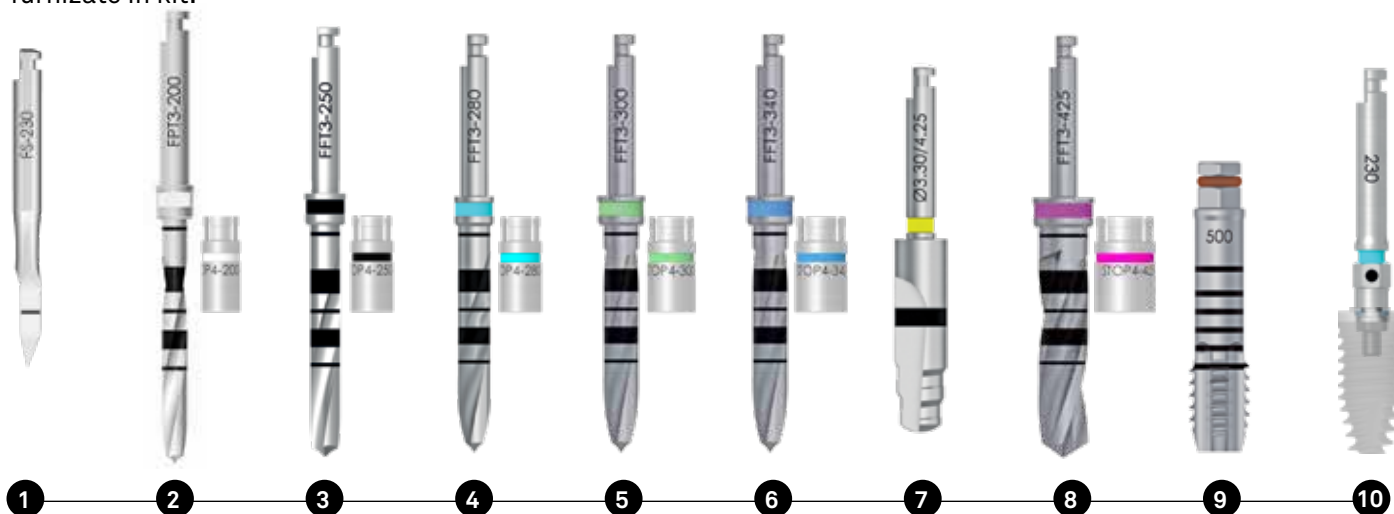Se recomandă, de asemenea, utilizarea opritoarelor de adâncime corespunzătoare lungimii de preparare dorite, furnizate în kit.



Secvența de utilizare a instrumentelor prezentată mai jos este valabilă pentru toate implanturile din gama Premium Power.


	$\varnothing$ 3.30 mm ●	$\varnothing$ 3.80 mm ●	$\varnothing$ 4.25 mm ●	$\varnothing$ 5.00 mm ●
1 Freză lanceolată		✓	✓	✓
2 Freză pilot cilindrică $\varnothing$ 2,00 mm	✓	✓	✓	✓
3 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 2,50 mm	✓	✓	✓	✓
4 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 2,80 mm		✓	✓	✓
5 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 3,00 mm			✓	✓
6 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 3,40 mm				✓
7 Freză intermediară $\varnothing$ 3,30/4,25 mm				✓
8 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 4,25 mm		✓	✓	✓
9 Tarod	A-MS-330	A-MS-380	A-MS-425	A-MS-500
10 Driver scurt Easy Insert	✓	✓	✓	✓

Utilizarea instrumentelor evidențiate este lăsată la aprecierea și experiența clinicianului, în funcție de calitatea osului receptor.

Secvențe de preparare a sitului implantar pentru implanturile Premium Power cu freze Shorty

Secvența ilustrată mai sus reprezintă un exemplu de preparare pentru un implant Premium Power cu lungimea de 7,00 mm și diametrul $\varnothing$ 5,00 mm.

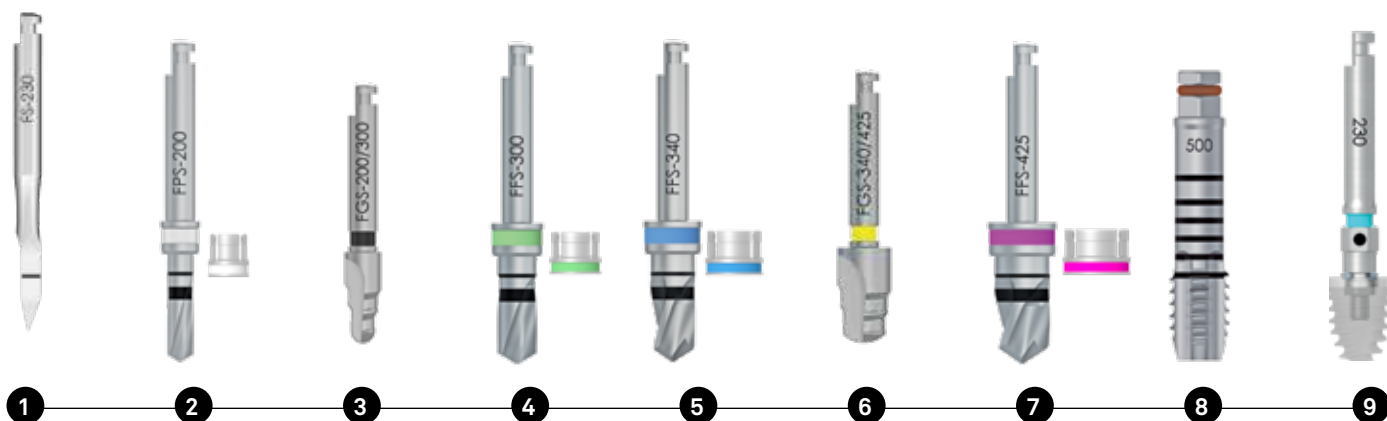Se recomandă, de asemenea, utilizarea opritoarelor de adâncime corespunzătoare lungimii de preparare dorite, furnizate în kit.



Secvența de utilizare a instrumentelor prezentată mai jos este valabilă pentru toate implanturile din gama Premium Power cu înălțimea de 7 mm.

	$\varnothing$ 4.25 mm ●	$\varnothing$ 5.00 mm ●
1 Freză lanceolată	✓	✓
2 Freză pilot cilindrică $\varnothing$ 2,00 mm	✓	✓
3 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 2,50 mm	✓	✓
4 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 3,00 mm	✓	✓
5 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 3,40 mm	✓	✓
6 Freză intermediară $\varnothing$ 3,40/4,25 mm	✓	✓
7 Freză finală cilindrică $\varnothing$ 4,25 mm	✓	✓
8 Tarod	A-MS-425	A-MS-500
9 Driver scurt Easy Insert	✓	✓

Utilizarea instrumentelor evidențiate este lăsată la aprecierea și experiența clinicianului, în funcție de calitatea osului receptor.

Secvențe de preparare a sitului implantar pentru implanturile Shelta Power

Secvența ilustrată mai sus reprezintă un exemplu de preparare pentru un implant Shelta Power cu lungimea de 11,50 mm și diametrul $\varnothing$ 5,00 mm.

Se recomandă, de asemenea, utilizarea opritoarelor de adâncime corespunzătoare lungimii de preparare dorite, furnizate în kit.



Secvența de utilizare a instrumentelor prezentată mai jos este valabilă pentru toate implanturile din gama Shelta Power.

	$\varnothing$ 3.80 mm ●	$\varnothing$ 4.25 mm ●	$\varnothing$ 5.00 mm ●
1 Freza lanceolată	✓	✓	✓
2 Freza pilot cilindrică $\varnothing$ 2,00 mm	✓	✓	✓
3 Freza finală cilindrică $\varnothing$ 2,50 mm	✓	✓	✓
4 Freza finală conică $\varnothing$ 3,80 mm	✓	✓	✓
5 Freza finală conică $\varnothing$ 4,25 mm		✓	✓
6 Freza finală conică $\varnothing$ 5,00 mm			✓
7 Tarod	SH-MS-380	SH-MS-425	SH-MS-500
8 Driver scurt Easy Insert	✓	✓	✓

Utilizarea instrumentelor evidențiate este lăsată la aprecierea și experiența clinicianului, în funcție de calitatea osului receptor.



rev. 06-26v.01



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com
www.prama.sweden-martina.com

Sweden Martina Romania srl
Strada Wilhelm Filderman nr. 18 Sector 3
030866 București - România
Sediu: 0040 0374 96 88 55
info.ro@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Implanturile, componentele protetice și instrumentele chirurgicale prezente în această publicație sunt Dispozitive Medicale și sunt fabricate de Sweden & Martina S.p.A., cu excepția:

- Locator Abutment și componentele aferente sunt dispozitive medicale fabricate de Zest Anchors, Inc., 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, CA 92010, SUA. Locator este o marcă înregistrată a Zest Anchors, Inc.
- Piloni Dynamic Abutment, Interfață Dinamică și componentele aferente sunt dispozitive medicale fabricate de Talladium España S.L., Avenida Blondel, 54 3º, 25002 Lleida, Spain. Dynamic Abutment și Interfață Dinamică sunt mărci înregistrate ale Talladium.
- Cheia dinamometrică cu pârghie de control TWL și adaptorul aferent sunt dispozitive medicale fabricate de Elos Medtech Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gorlose, Danemarca.
- Capace pentru cuplaje sferice, dispozitive medicale fabricate de Rhein83 S.r.l., Via E. Zago 10/ABC, 40128 Bologna, Italia.

Articolele prezente sunt conforme cu standardele ISO 9001 și ISO 13485 și sunt înregistrate cu marcaj CE în conformitate cu Regulamentul (UE) Dispozitive Medicale nr.2017/745. Fabrica Sweden & Martina produce Dispozitive Medicale în conformitate cu cGMP-urile în vigoare în SUA și în alte țări din lume.



Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele.
Toate mărcile comerciale din publicație sunt proprietatea Sweden & Martina, cu excepția produselor pentru care este indicat altfel. Aceste produse sunt destinate cabinetelor medicale și laboratoarelor, vânzarea lor nu se adresează pacientului.
Este interzisă revinderea, duplicarea sau distribuirea produselor conținute în această publicație fără acordul scris al Sweden & Martina S.p.A.
Pentru mai multe informații despre produse, inclusiv indicații, contraindicații, avertismente, precauții și potențiale efecte secundare, vă rugăm să consultați site-ul web Sweden & Martina S.p.A.
Conținutul este actualizat la momentul publicării. Vă rugăm să contactați Suedia și Martina pentru actualizări suplimentare.